
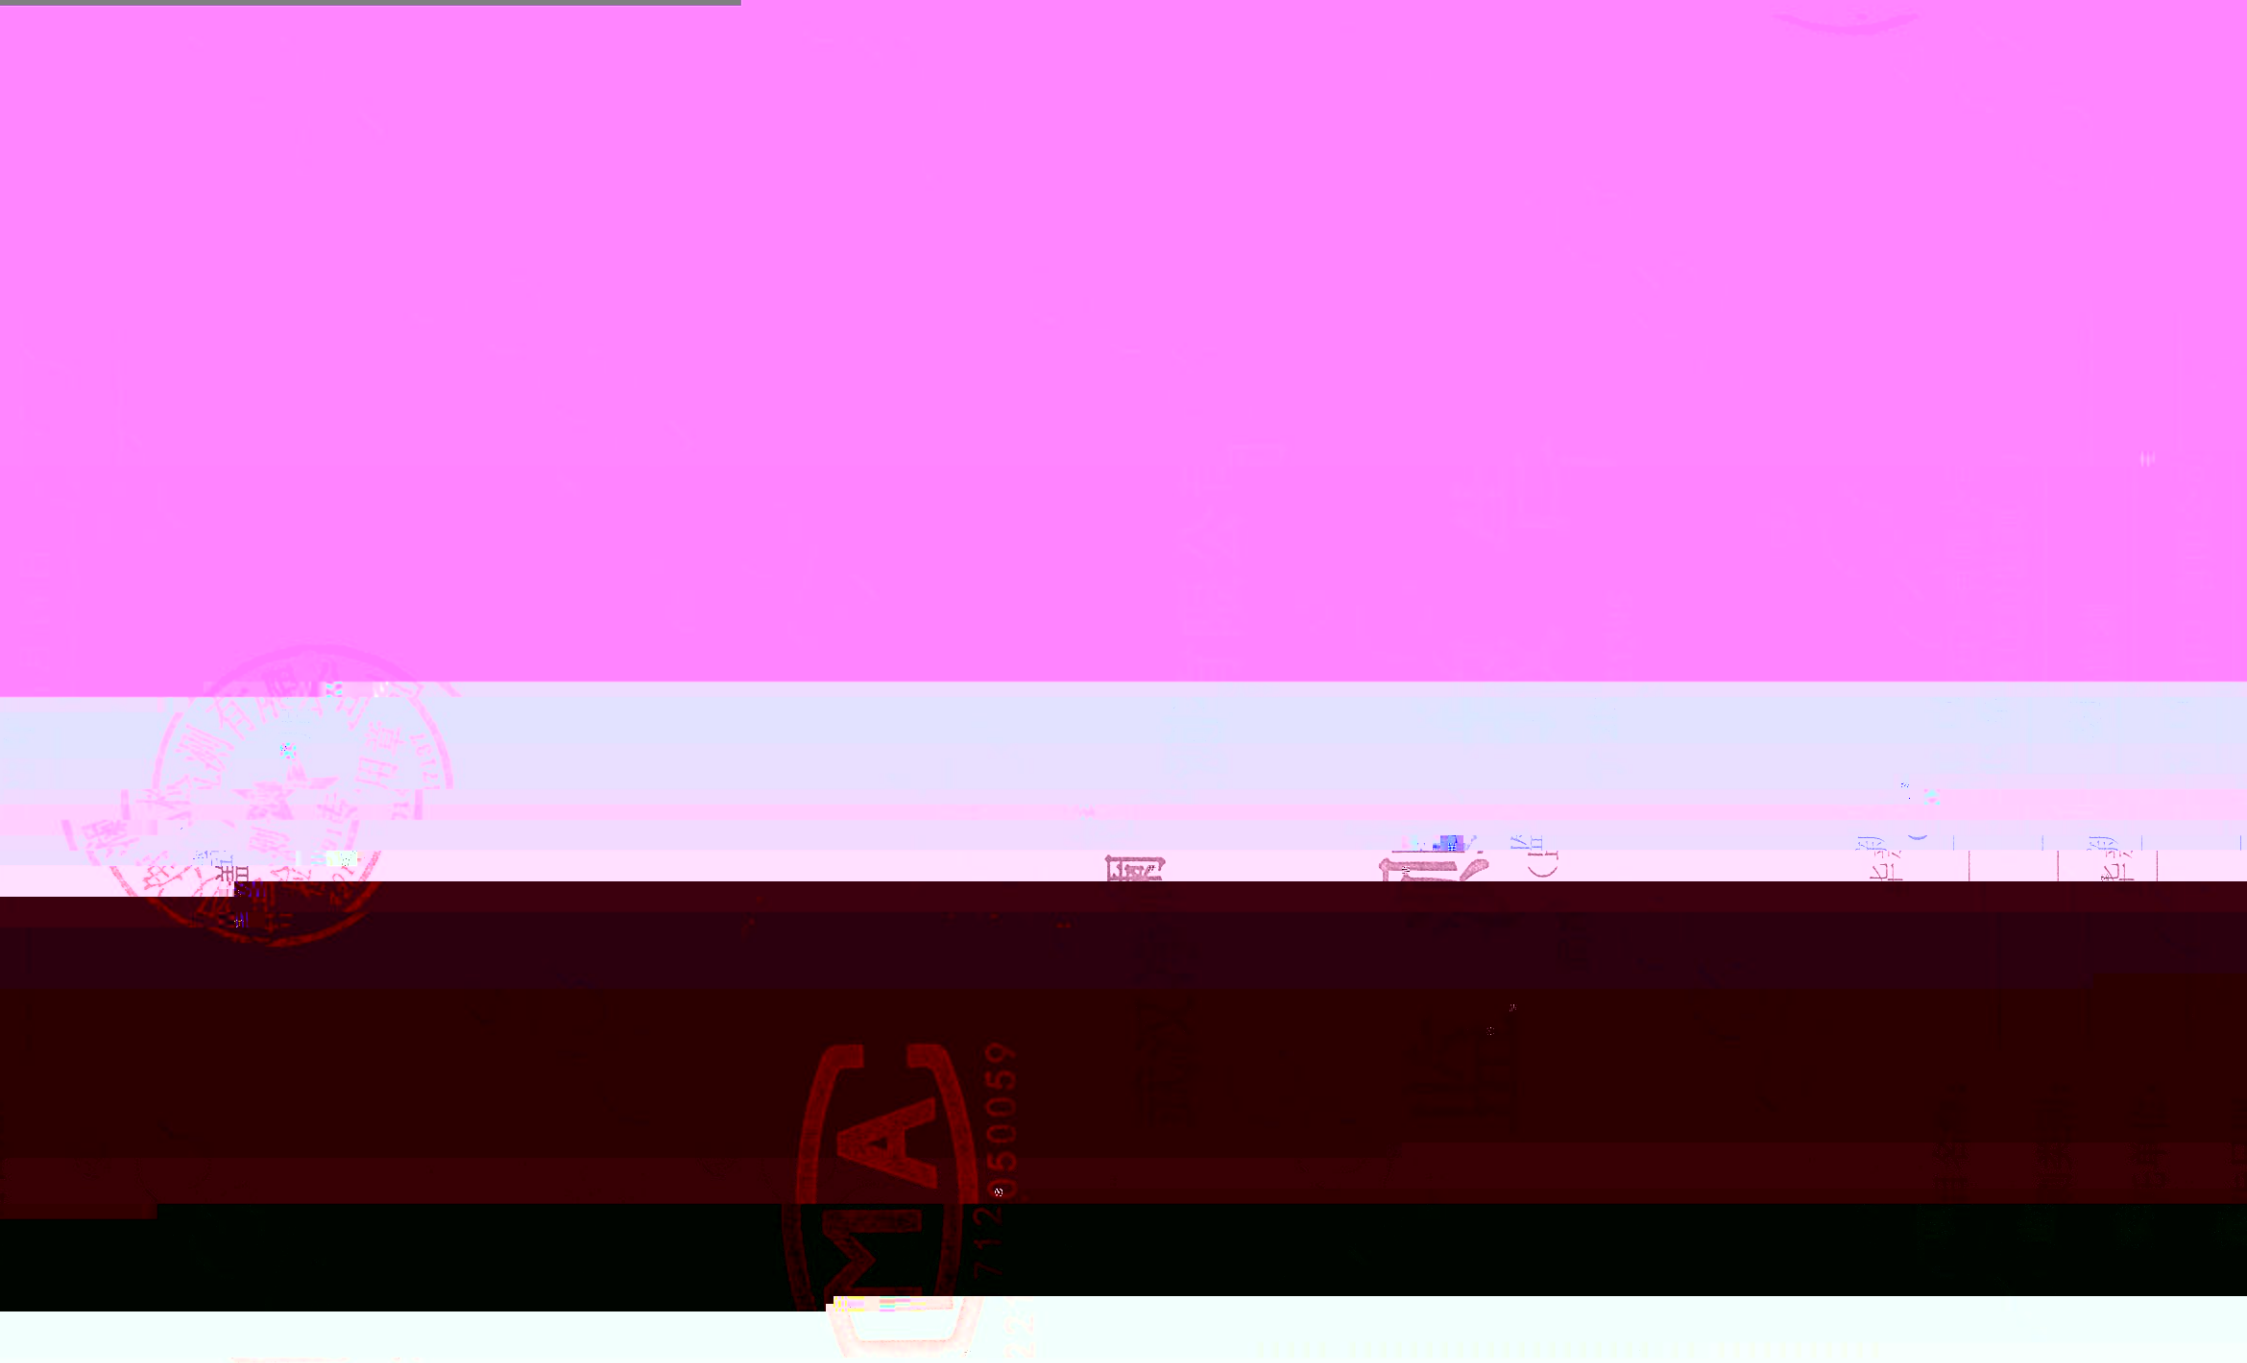


1. 报告
2. 报告
3. 对本
提出，
逾期
4. 若由
不对
样品来
负责。
5. 未经
复印
件应由
公司
6. 除客
品均
别
不再留样
。
7. 本报
告不得

本公
公

邮
电

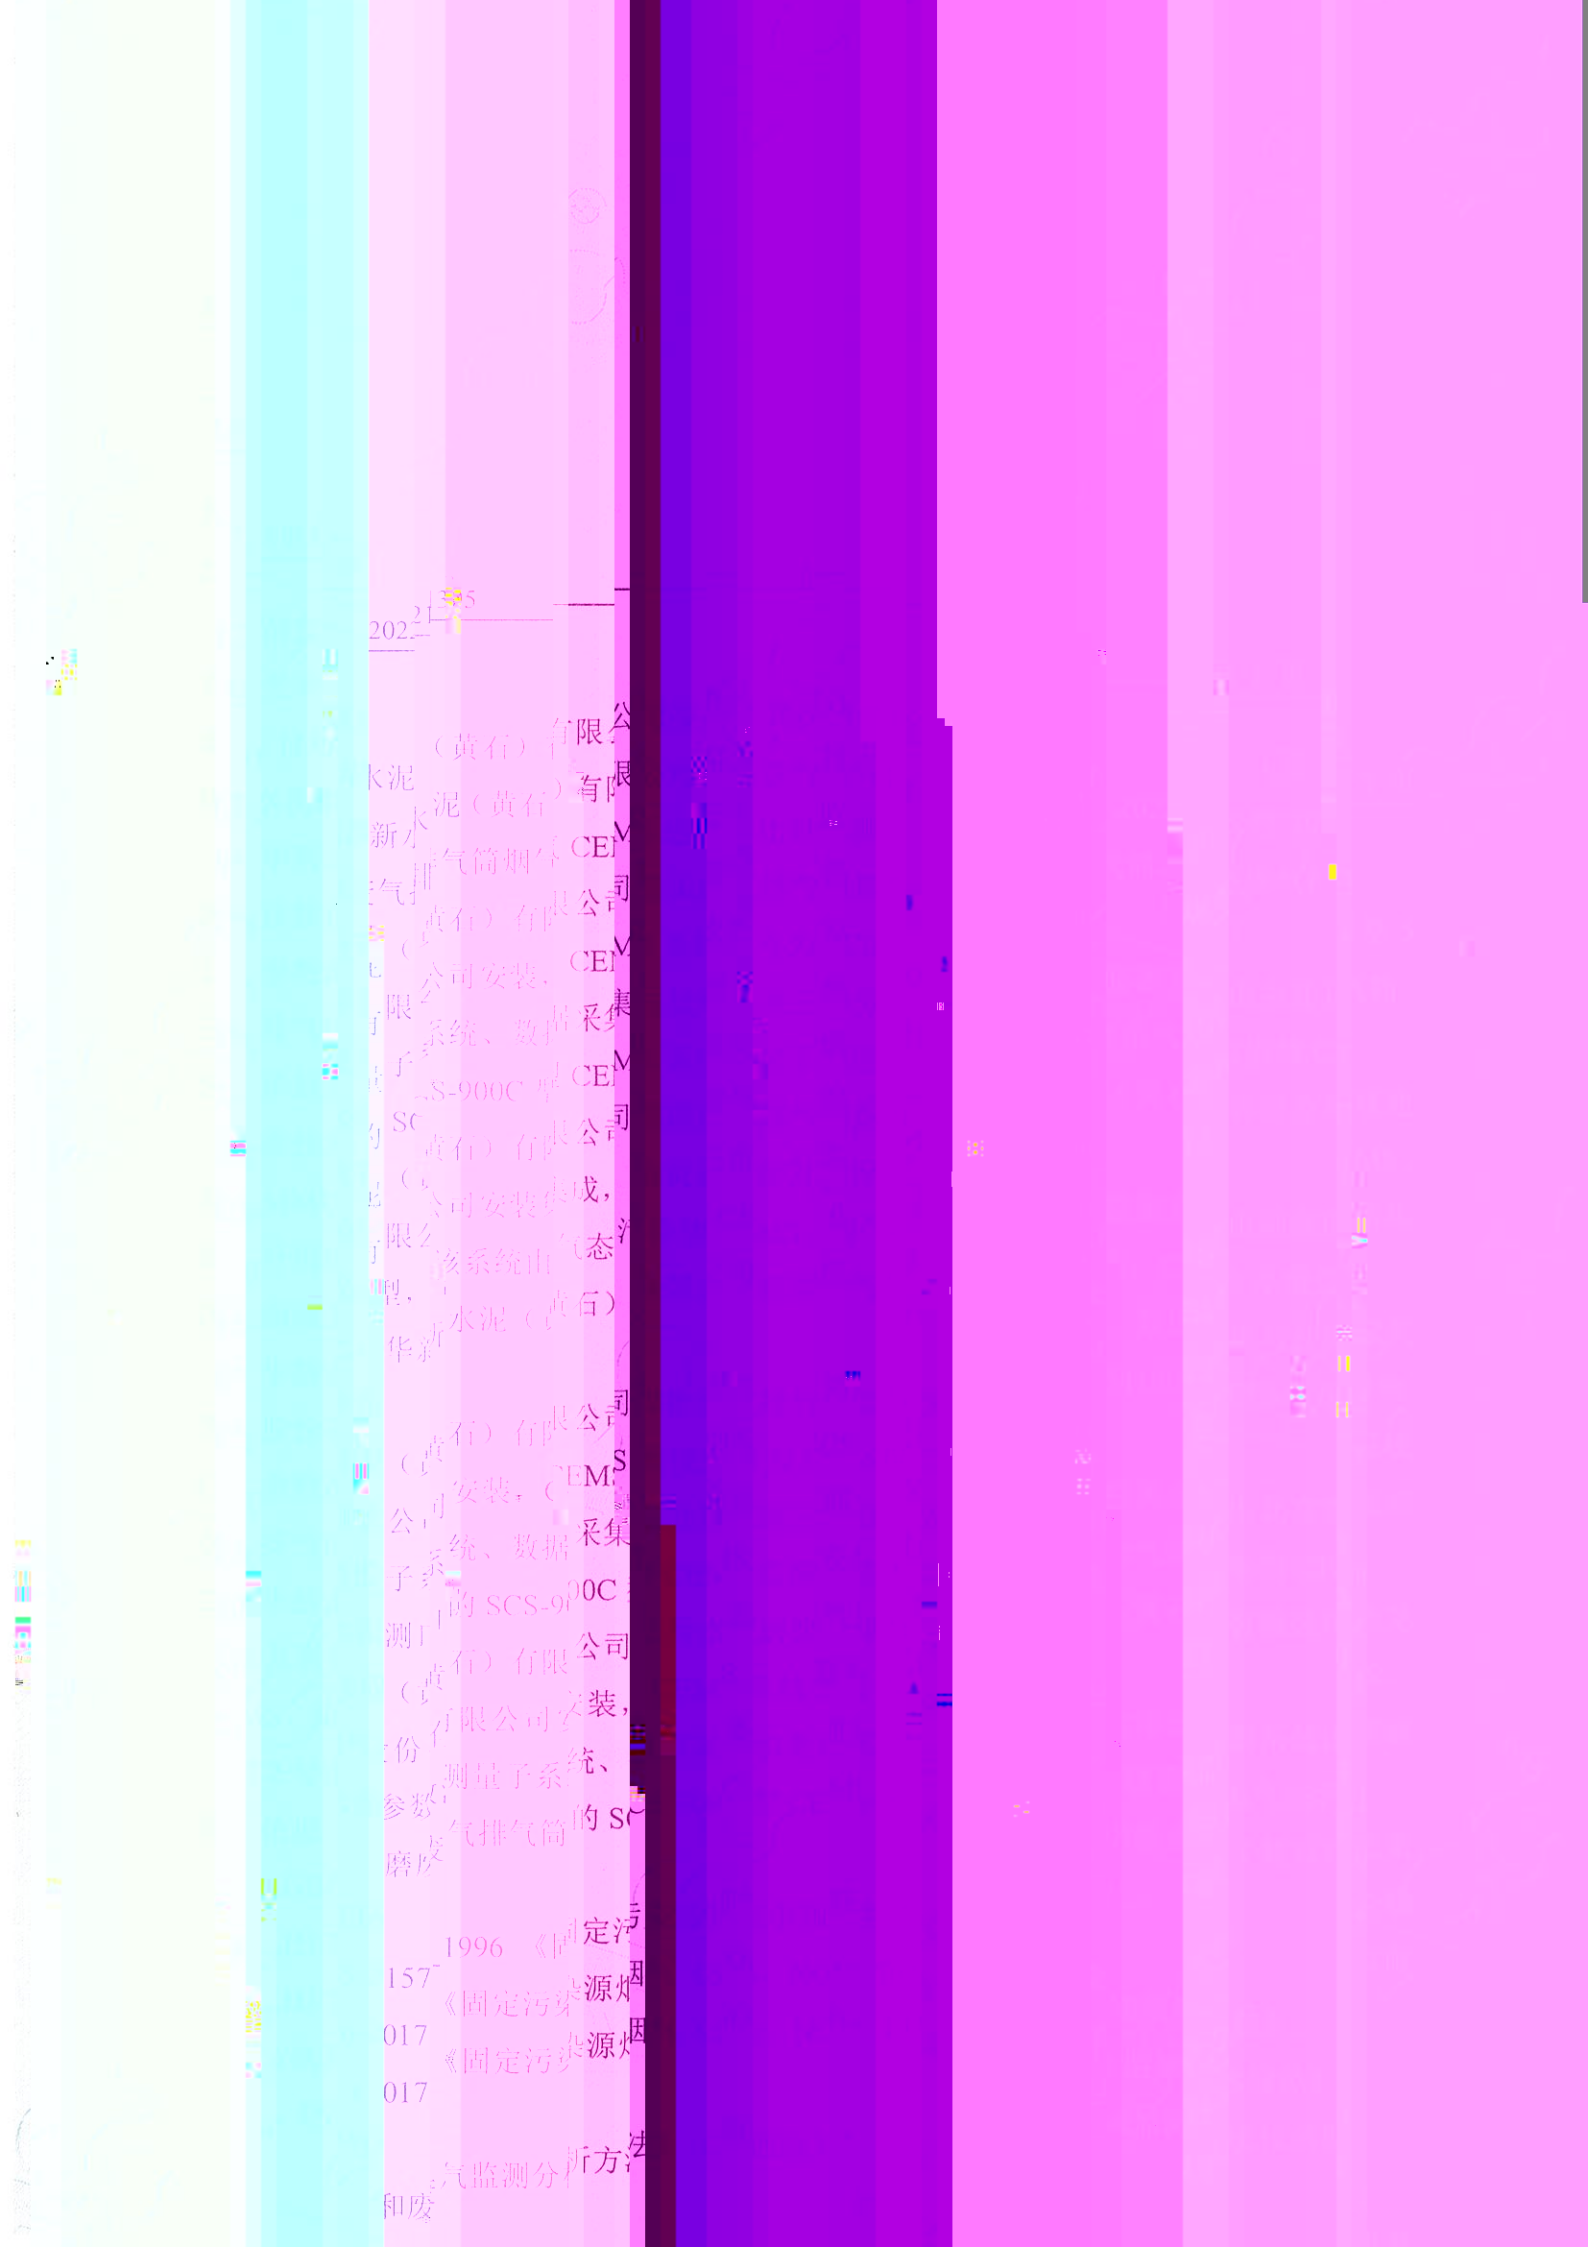

武

三 字 20221 395

争（监

、标准

比对项目

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

氧气

其它气态污染物

流速

温度

四、

湿度

物以 NO2 计

：氮氧化

工况 间该厂生产

监测期

武

王

源

颗粒

烟气流

烟气温

烟气湿

参照

颗粒

烟气

烟气

烟气

结论

武净


（监）字 2022 21395

测试

点位： 窑尾 废气

项目	名称	参比
颗粒物	CEMS颗粒物分析仪	E
烟气流速	烟气流速分析仪	E
烟气温度	烟气温度分析仪	E
二氧化硫	二氧化硫分析仪	E
氮氧化物	氮氧化物分析仪	E
氧量	氧量分析仪	E

项目	时间	参比
颗粒物	13:30~14:09	6
	14:18~14:57	4
	15:07~15:46	4
	均值	5
烟气流速	13:30~14:09	7
	14:18~14:57	6
	15:07~15:46	6
	均值	6
烟气温度	13:30~14:09	16
	14:18~14:57	15
	15:07~15:46	15
	均值	15
二氧化硫	13:45~13:49	
	14:32~14:36	
	15:10~15:14	
	均值	
	15:56~16:00	
	16:28~16:32	
	16:55~16:59	
	均值	

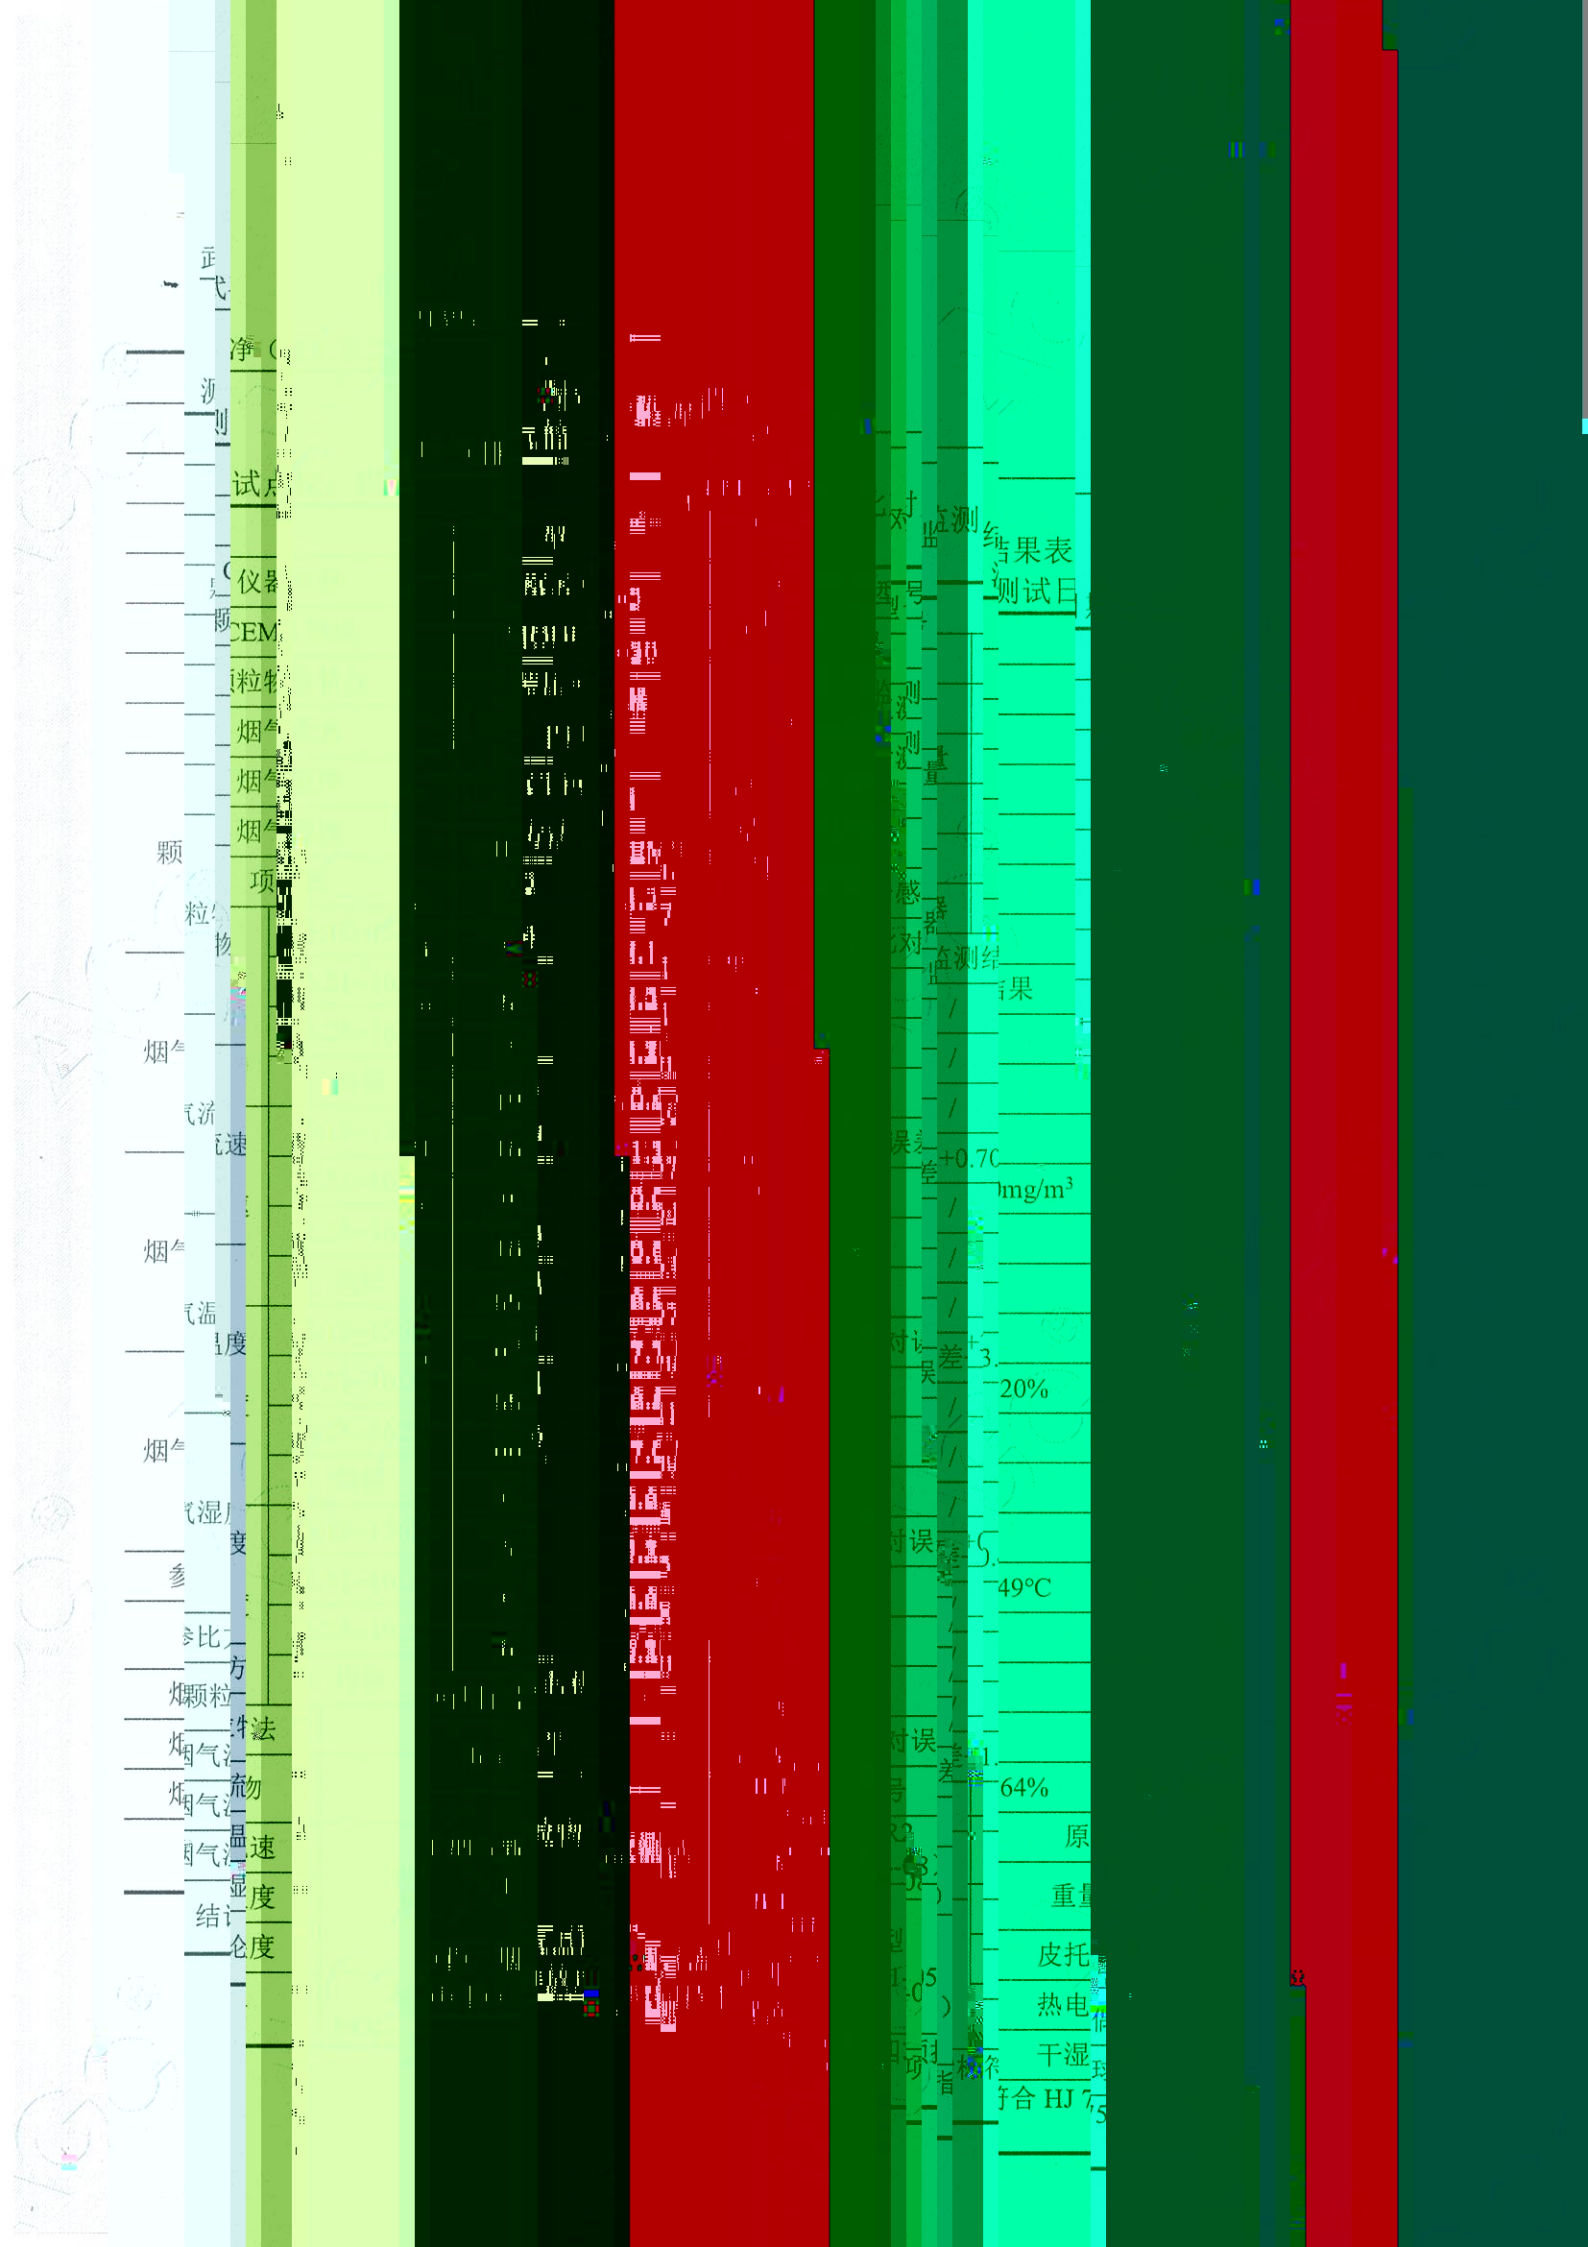

武

字 202213 95

测

固定

2 号水泥磨 废气排

型 号

SCS-900

MODEL2

差压变

PT100

化方法

颗粒物	~9:19	4.3
	~9:59	5.7
	~10:42	5.3
	均值	5.1
烟气流速	~9:19	5.9
	~9:59	5.6
	~10:42	5.4
	均值	5.6
烟气温度	~9:19	6.4
	~9:59	1.0
	~10:42	7.0
	均值	1.5

参比方

所用仪器名称

颗粒物 天平

烟气流

烟气温 烟尘烟 颗粒物浓度

义 物

结论

颗粒物、烟气温度、

）排放连续监测技术规

2022-06-14

MS 比对

仪器型

在线监测

向散射

托管法

电阻法

比对

绝对误

相对

绝

对误

号

0/220 R2

JC-00 4-08

3300 型

CY-1 11-0

标符合

束 ***

-06-