

武汉净

监

武

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：



1. 报告无本公司

2. 报告涂改、

3. 对本检测报告

提出，逾期不予受理

4. 若由委托单位

不对样品来源负责。

5. 未经本公司书

复印件应由我公司加

6. 除客户特别申

品均不再留样。

7. 本报告不得用

本公司


公司

公司

司：

邮政

电

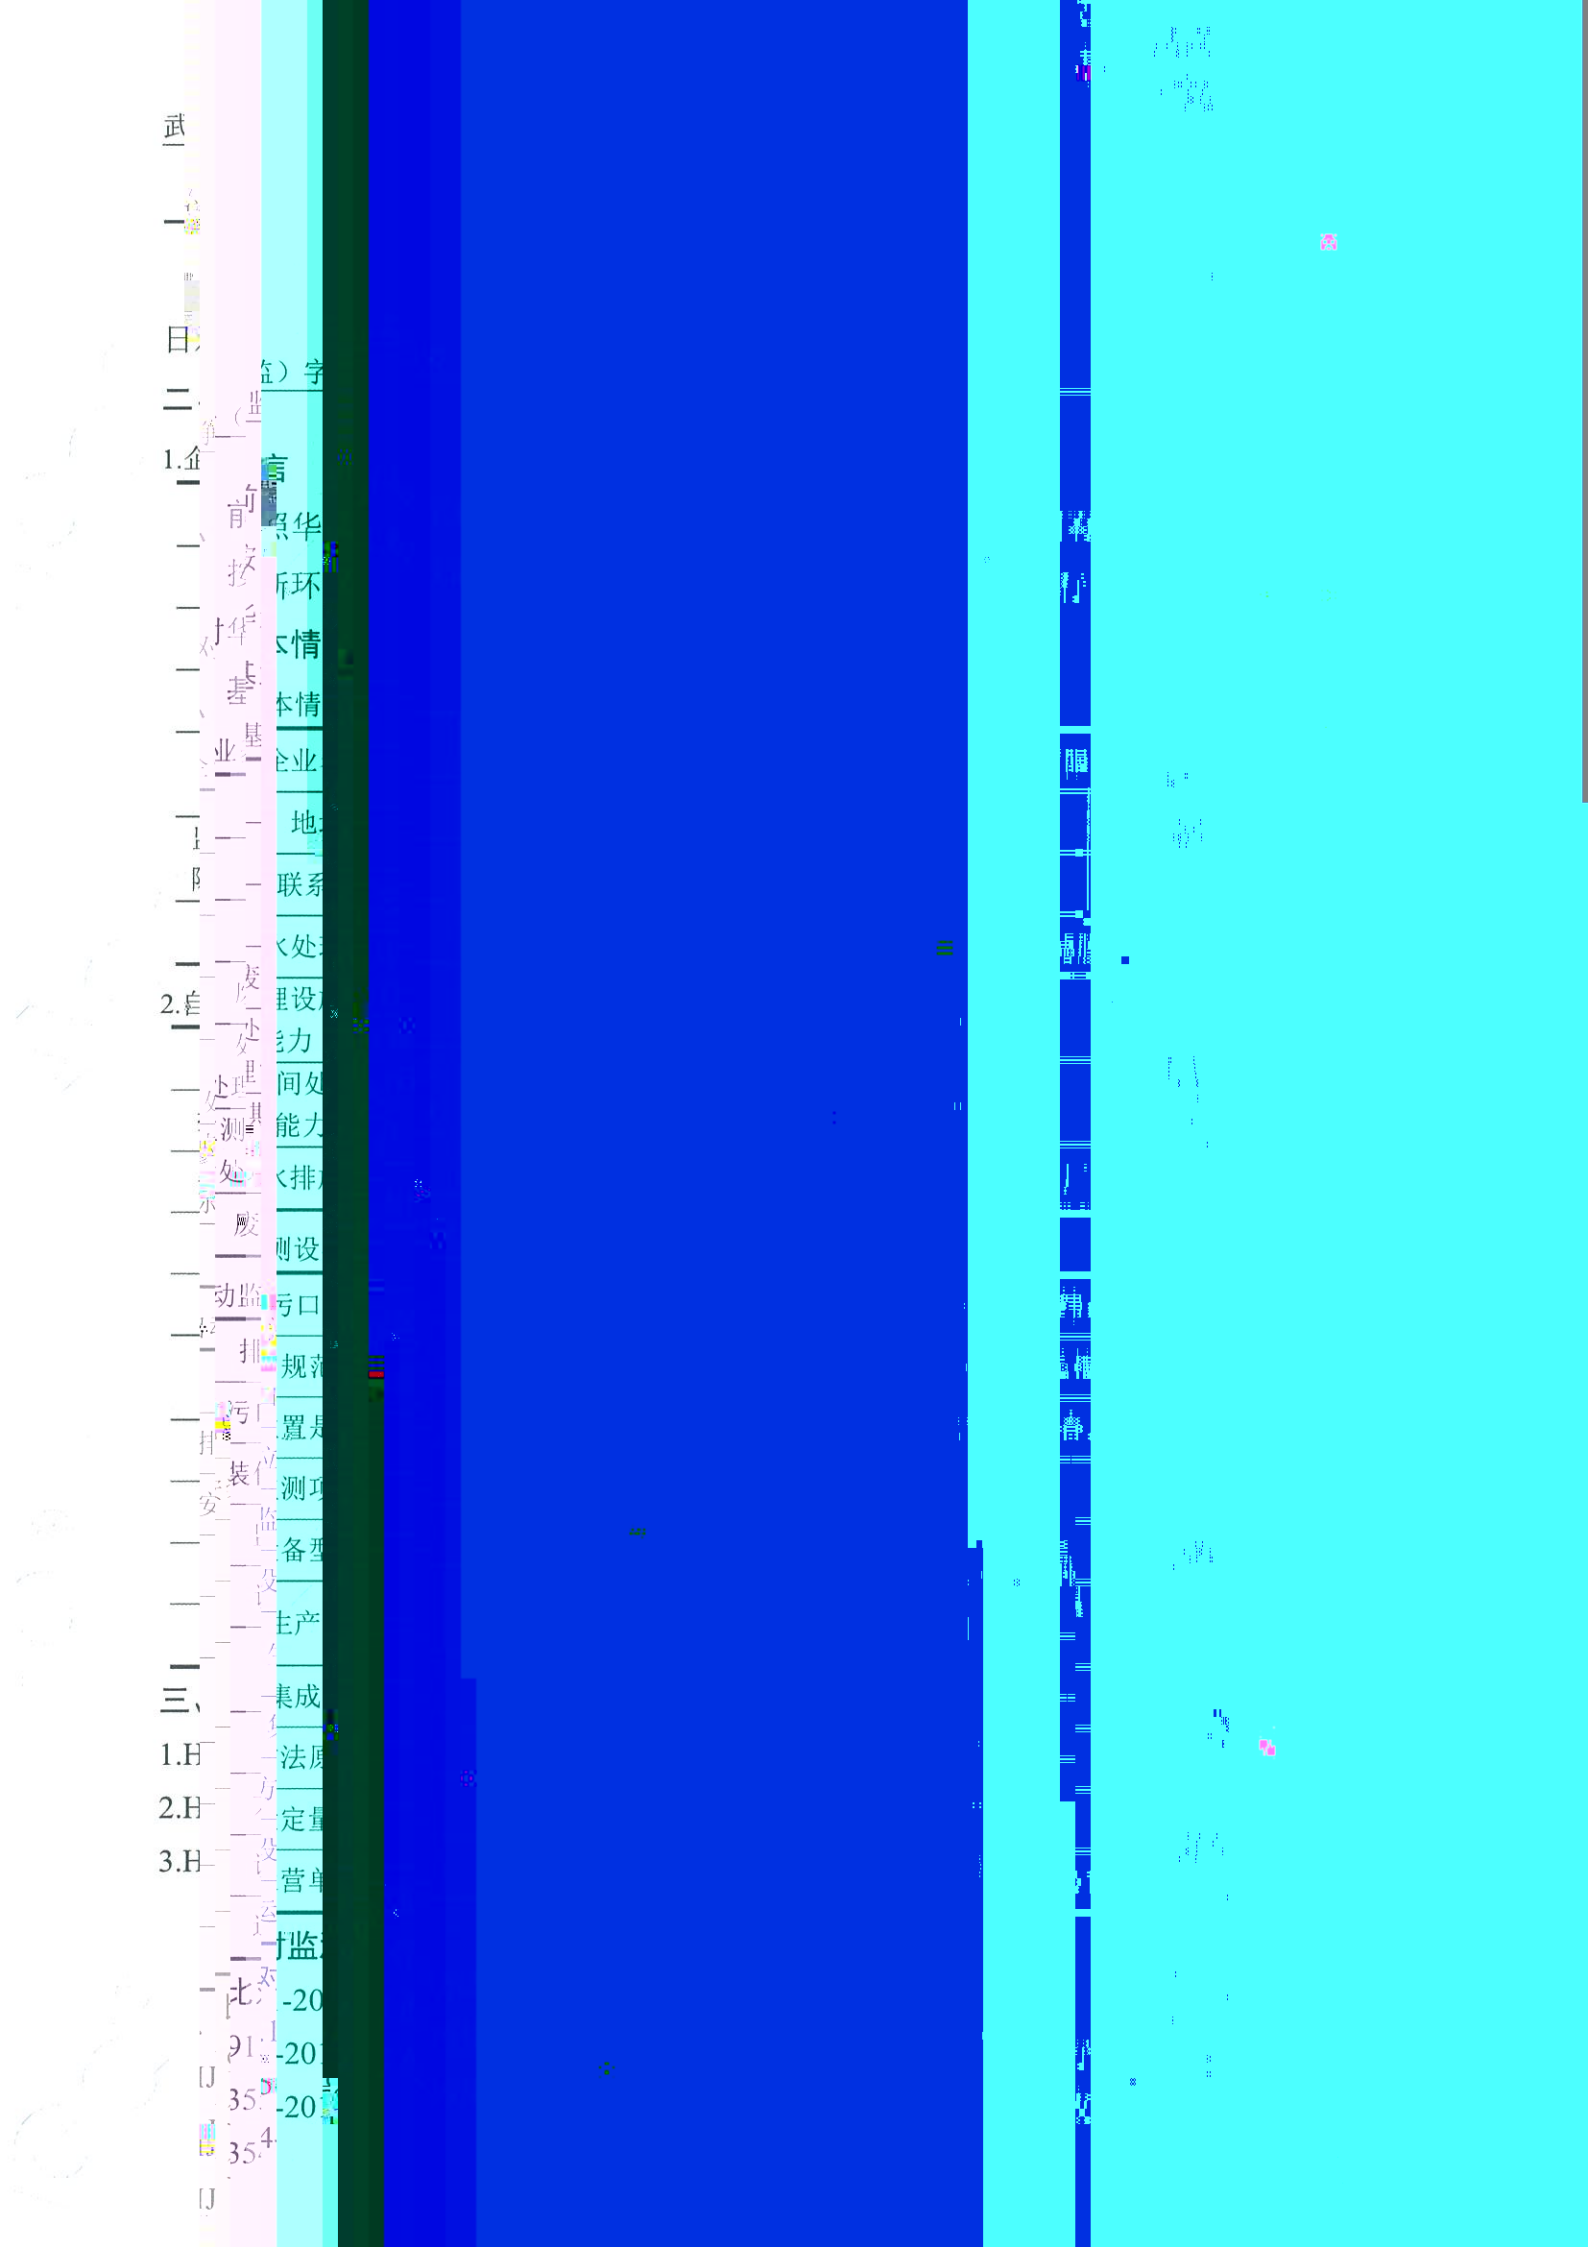

武

四、 争（监）字 2022349

2

评价标准

表 1 水污染源在线监测仪器验收项目及

仪器类型		技术指标要求	指标限值	
CODCr、TOC 水质自动分析仪	采用浓度约为	工作量程上限值 0.5 倍标准样品	±10%	比对满足要求
	（用浓度为 20	CODCr < 30mg/L 的标准样品替代实际水样进行测试）	±5mg/L	
	30mg/L≤实际水样 CODCr < 60mg/L		±30%	
	60mg/L≤实际水样 CODCr < 100mg/L		±20%	
	实际水样 CODCr≥100mg/L		±15%	
NH3-N 水质自动分析仪	采用浓度约为	工作量程上限值 0.5 倍标准样品	±10%	同步
	（用浓度为 1.5mg/L	氨氮 < 2mg/L 的有证标准样品替代实际水样进行测试）	±0.3mg/L	
	实际水样氨氮≥2mg/L		±15%	
pH 水质自动分析仪		实际水样比对	±0.5	

五、工况

监测期间该厂生产正常，比对监测与在线自动监测在同一生产


六、监测结果

1. 废

试

自

北

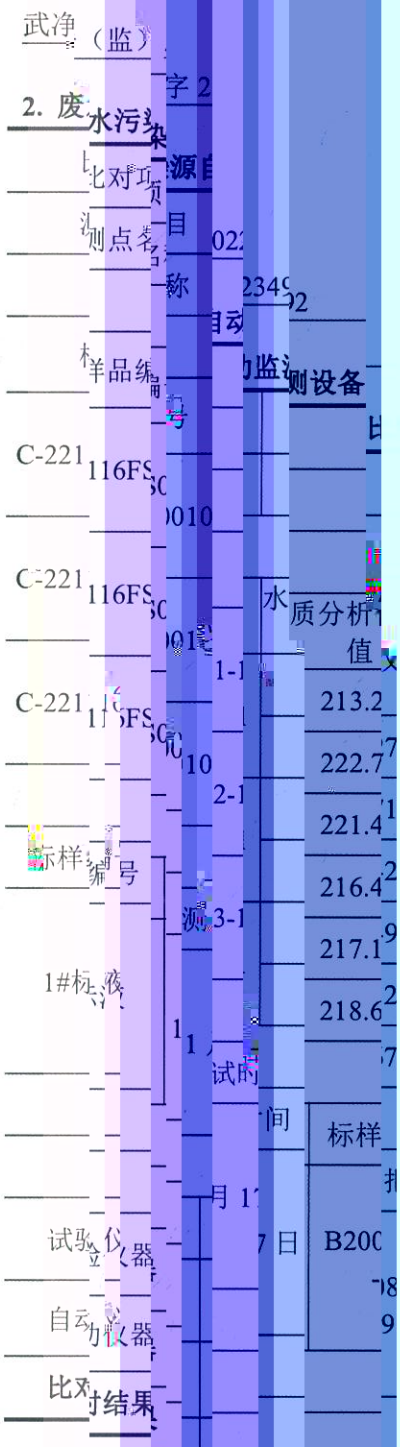
武净（监）
2. 废水污染
比对项
测点名
称
样品编
号
C-221
116FS
C-221
116FS
C-221
标样编号
1#标液
试验仪器
自动仪器
比对结果
测设备
水
质分析
值
213.2
222.7
221.4
216.4
217.1
218.6
标样
B200
铬酸盐
重
第
2022 年 1
2022 年 1
标准限值
±15%
±15%
±15%
标准限值
±10%
编号
15010