CMA
221712050059

武汉净

监 测

（监

武净

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

（加盖检

1. 报告无本公司检测

2. 报告涂改、缺页、

3. 对本检测报告若有

提出，逾期不予受理。

4. 若由委托单位自送样

不对样品来源负责。

5. 未经本公司书面批

复印件应由我公司加盖检测

6. 除客户特别申明并

品均不再留样。

7. 本报告不得用于商

本公司通

公司名称

公司地址

邮政编码

电　　话

武汉

202307 23

一、

泥（武穴

水泥（武穴

气筒烟

头排

（武穴）有限

公司制造

有限公

气参数

废气

（武穴

公司制造

有限公

测量子

排气筒

（武穴）有限

装，CE

并安

据采集

、数

MS 系

型 CE

（武穴）有限

装，CE

并安

据采集

、数

MS 系

型 CE

据

委托

司 K2

进行

窑尾

CE

据采

0D 型

司 K1

窑尾

CE

据采

CS9

0D 型

司 K1

窑头

MS 系

理处

直

垂

司 K2

窑头

MS 系

理处

直

垂

二、比

1.GB/T 1

2.HJ 75-2

3.HJ 76-2

方法》；

4.《空气

固定污染源排

染源烟气（SO

染源烟气（SO

NO

NO

监测分析方法》（第

版）

武汉[illegible]净（监）[illegible]字[illegible]20230723

三、评价标[illegible]


[illegible]准


比对项目			
颗粒物	准确度	排放浓度[illegible]	
		100[illegible]	mg/m³[illegible]
		50m[illegible]	g/m³[illegible]
		20m[illegible]	g/m³[illegible]
		10m[illegible]	g/m³[illegible]
二氧化硫	准确度	排放浓度[illegible]	
		排放浓度[illegible]	
		143m[illegible]	g/m³[illegible]
		57mg[illegible]	g/m³≤排[illegible]
		排放浓度<57[illegible]	
氮氧化物	准确度	排放浓度≥5[illegible]	
		103m[illegible]	g/m³≤排[illegible]
		41mg[illegible]	/m³≤排放[illegible]
		排放浓度<41[illegible]	
氧气	相对准确度	>5.0%[illegible]	时，相[illegible]
		≤5.0%[illegible]	时，绝[illegible]
流速	准确度	流速≥10m/s[illegible]	
		流速≤10m/s[illegible]	
温度	准确度	绝对误差不超[illegible]	
湿度	准确度	烟气湿度＞5.0[illegible]	
		烟气湿度≤5.0[illegible]	

备注：氮氧化物以 NO_2 计，以[illegible]各参数区间划分以[illegible]

四、[illegible]况

监测期间[illegible]厂生产正常，比对监测与[illegible]在线[illegible]

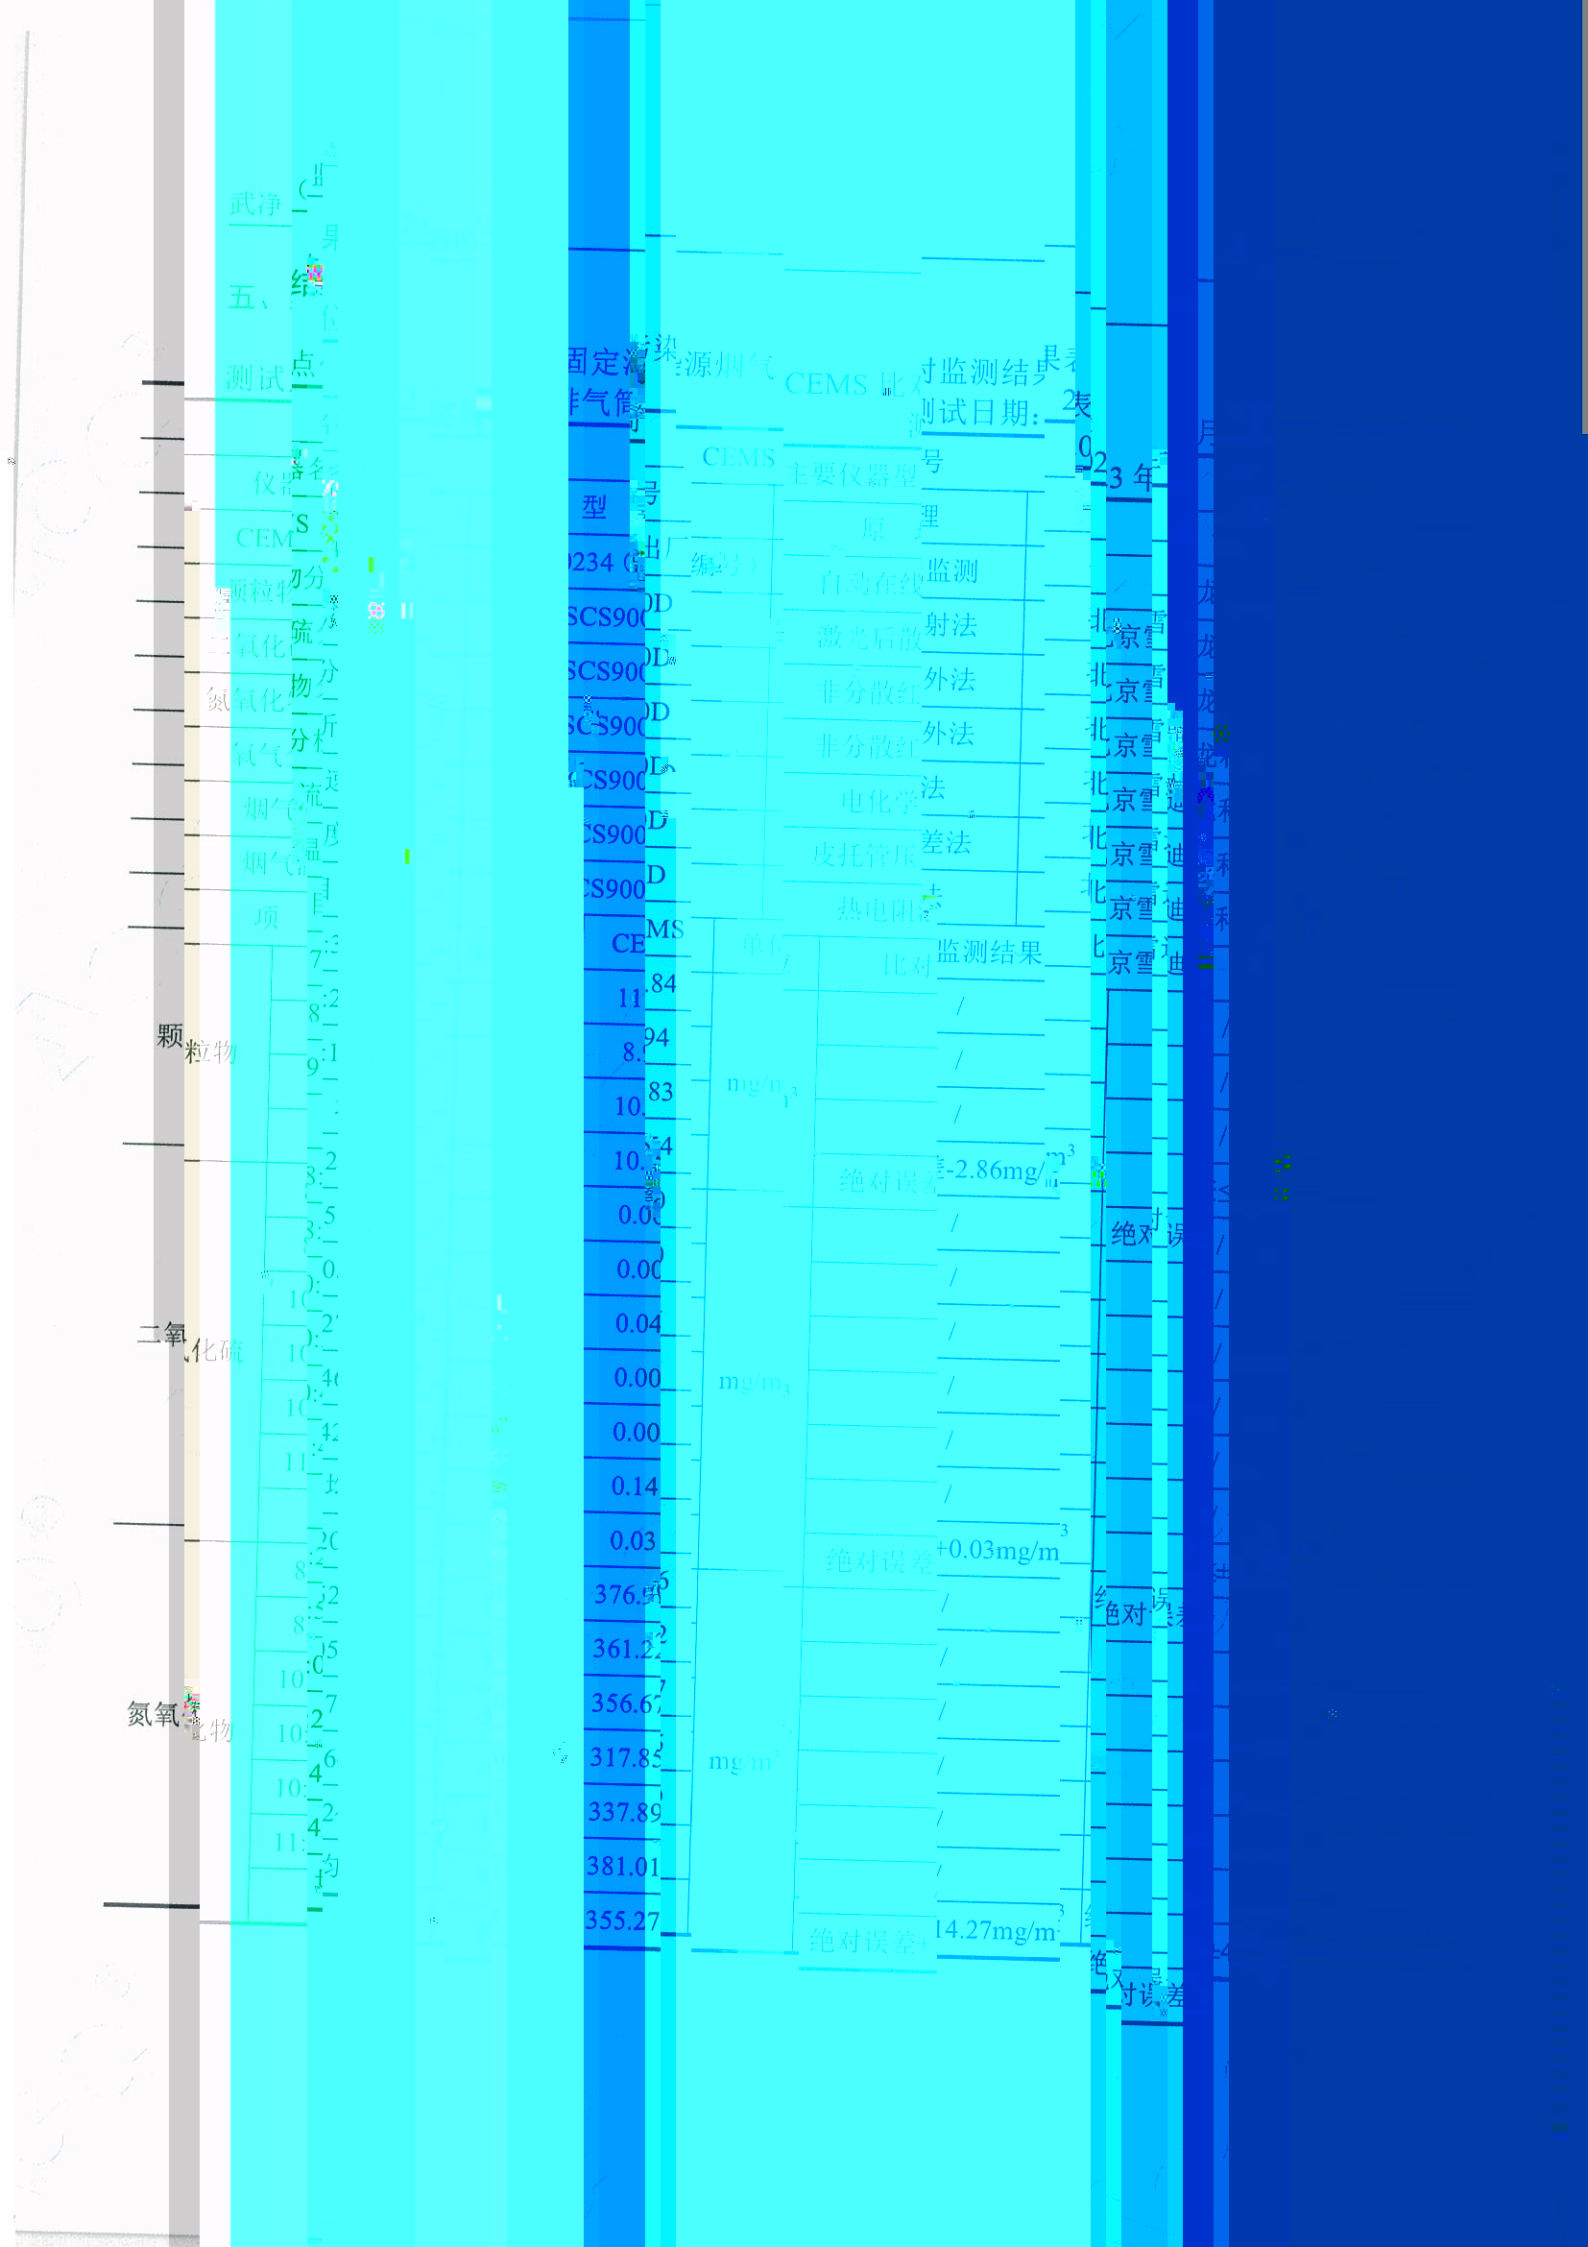

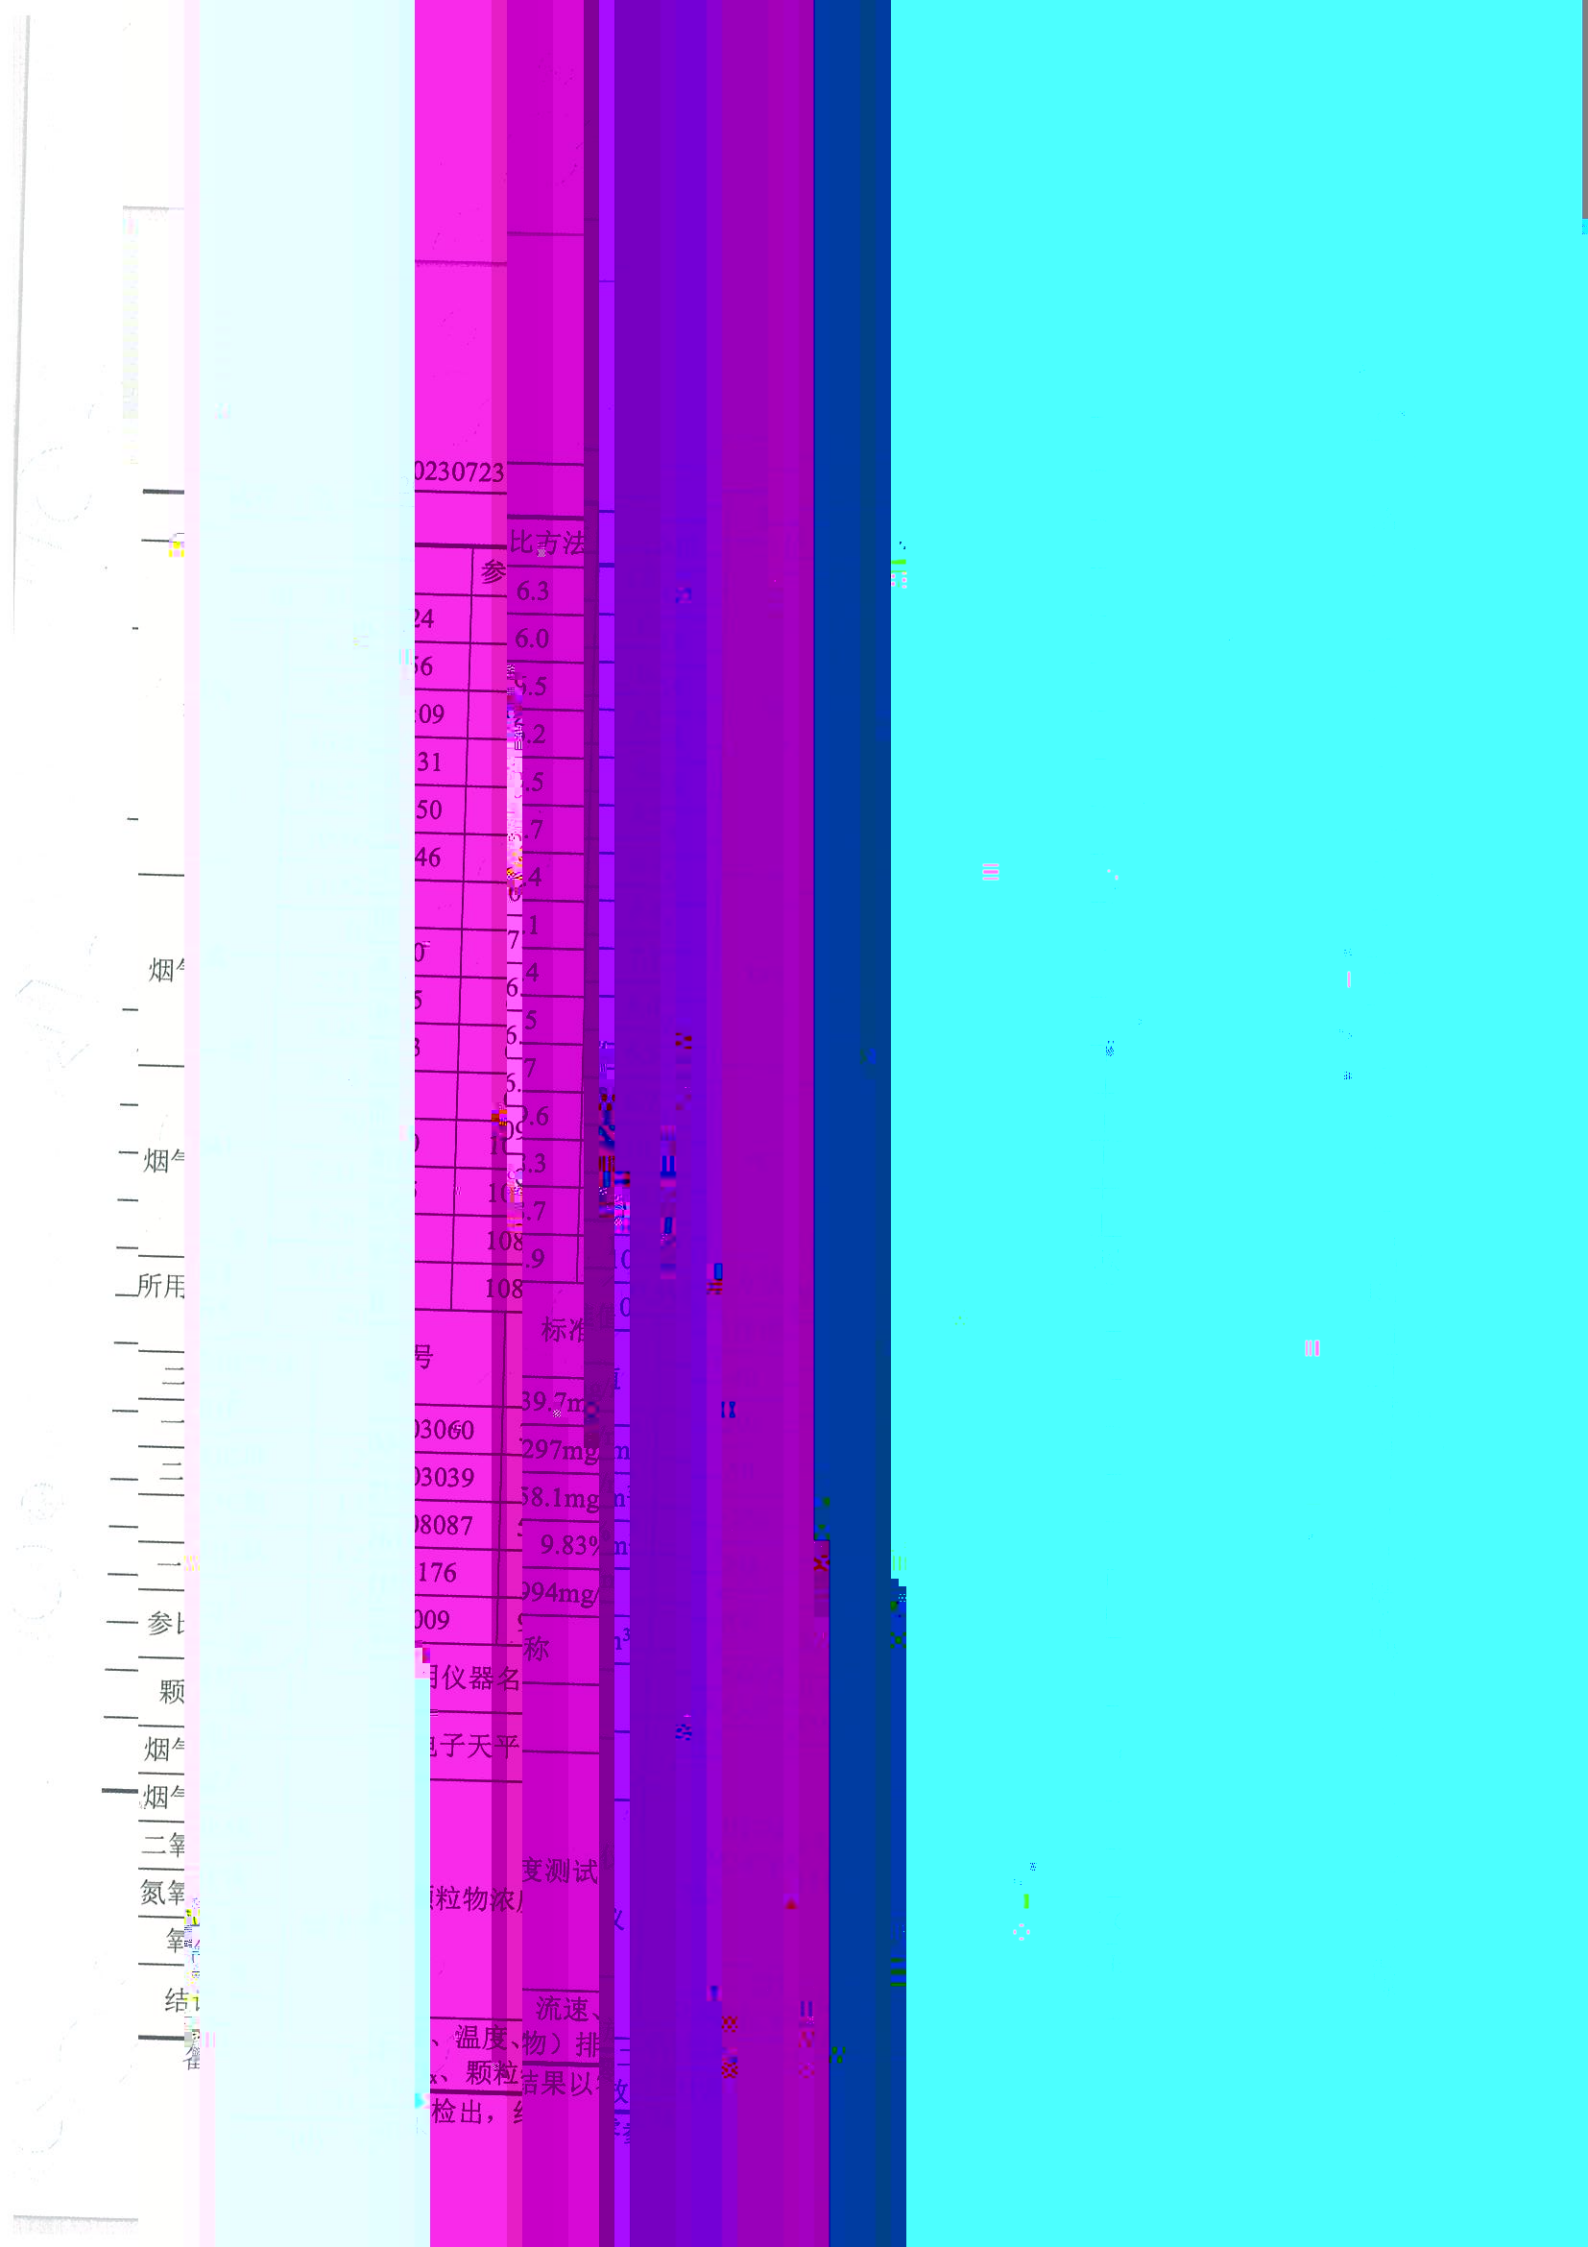

武

测

C

颗

二氧

氮氧

氧

烟

烟

项

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

1

武净（监

项	
氧气	7
	8
	8
	9:
	10:
	10:
烟气流速	7:2
	:0
	8:5
烟气溫度	7:2
	8:0
	8:5
湿度	7:21
	8:08
	8:58
所用标准气体名称	
二氧化硫	
一氧化氮	
二氧化氮	
氧气	
一氧化碳	

武净（监）

名称	型号、编号	原理	方法
平	AS60/220（JLJC-JC-00	.R2 04-08）	重量法	HJ 83
		皮托管法	
		热电偶法	GB/T 16
度测试仪	MH3300（JLJC-CY-1	型 11-02）	干湿球法	
		定电位电解法	HJ 57
		定电位电解法	HJ 693
		电化学法	GB/T 16

注：“(0)”未检出、流速、二氧化硫、氮氧化物、氧气、湿度七项指标符合 HJ 75 技术规范 要求。

结果以零参与计算。

武
测
仪
C
颗粒
烟
烟
项
颗粒物
烟气温度
烟气流速
参比方法
颗粒物
烟气流速
烟气温度
结论

武净（监

测试点位

项　目		
仪器名称		
CEMS 系统		
颗粒物分析		
烟气流速		
烟气温度		
颗粒物	8:0	
	8:49	
	9:35	
	均	
烟气流速	8:01	
	8:49	
	9:35~	
	均	
烟气温度	8:01~	
	8:49~	
	9:35~	
	均	
参比方法		
颗粒物		
烟气流速		
烟气温度		
结论		

编制

日期

固定污

气筒

型

03-(

Em

Em

Em

CE

方法

名称

平

浓度

测试仪

流

范》

要求

审

日期

16

制造单位

天科技有限公司

天科技有限公司

科技有限公司

科技有限公司

结果评定

/

/

合格

/

/

/

合格

/

/

/

合格

检出限

(mg/m³)

1.0

--

--

排

（颗粒物）

9 页 共 9 页