

武汉净澜检

监 测 报 告

武净（监

字 2022

项目名称：华新

C

监测类别：

水泥（黄石

委托单位：华新 EMS

委托监

2

水泥（黄石）

022 年 11 月

（加盖检

测专用章）

声　明

1.　　章、骑缝章

2.　　无效，报告

3.　　，请于收到

提出，逾

4.　　的检测，本公

不对样品

5.　　不得部分复制

复印件应

6.　　品管理费，

品均不再

7.　　，违者必

料：

汉净澜检测

汉东湖新技

道 52 号（武

业园）B 地块

065

-81736778

武净（监）字 20
223387

3.HJ 76-201
7《固定污
检测方法》；

4.《空气和
废气
三、评价标准
监测分析方法》

比对
项目

颗粒物

准确度

二氧化硫

准确度

氮氧化物

准确度

氧气

相对准确度

流速

温度

准确度

湿度

准确度

备注：氮氧化物以
NO_2 计

四、工况

监测期间该
厂生产

烟气

CEMS 比对监测结果表

EMS

主要仪器名称	型号										
颗粒物	原位激光后向散射皮托管离子单位	自动在线监测系统	监测量	热电偶流速传感器	对监测结果						
烟气流速											
烟气温度	mg/m³										
参比方法											
颗粒物	m/s										
烟气流速											
烟气温度	℃										
结论											

3 页 共

年 11 月

位

mg/m

12%

℃

方法

GB/T 1615

(SO2 NO

绝对误差-1.05mg/m

对误差-3.75%

对误差0.29℃

A型号、

（JLJS60/22


NC-JC-(0.[-3）


（JLJMH330

速三环C-CY-0.[-5）

求。指标符合《 HJ 75-2017

/
/
合格
g/n m³
4 页 共 8 页
11 月 8 日
位
技有限公司
技有限公司
有限公司
有限公司
有限公司
有限公司
有限公司
颗
烟气
结果
合
ng/ m³
合
二等
2%
合
3°C
/
/
/
/
/

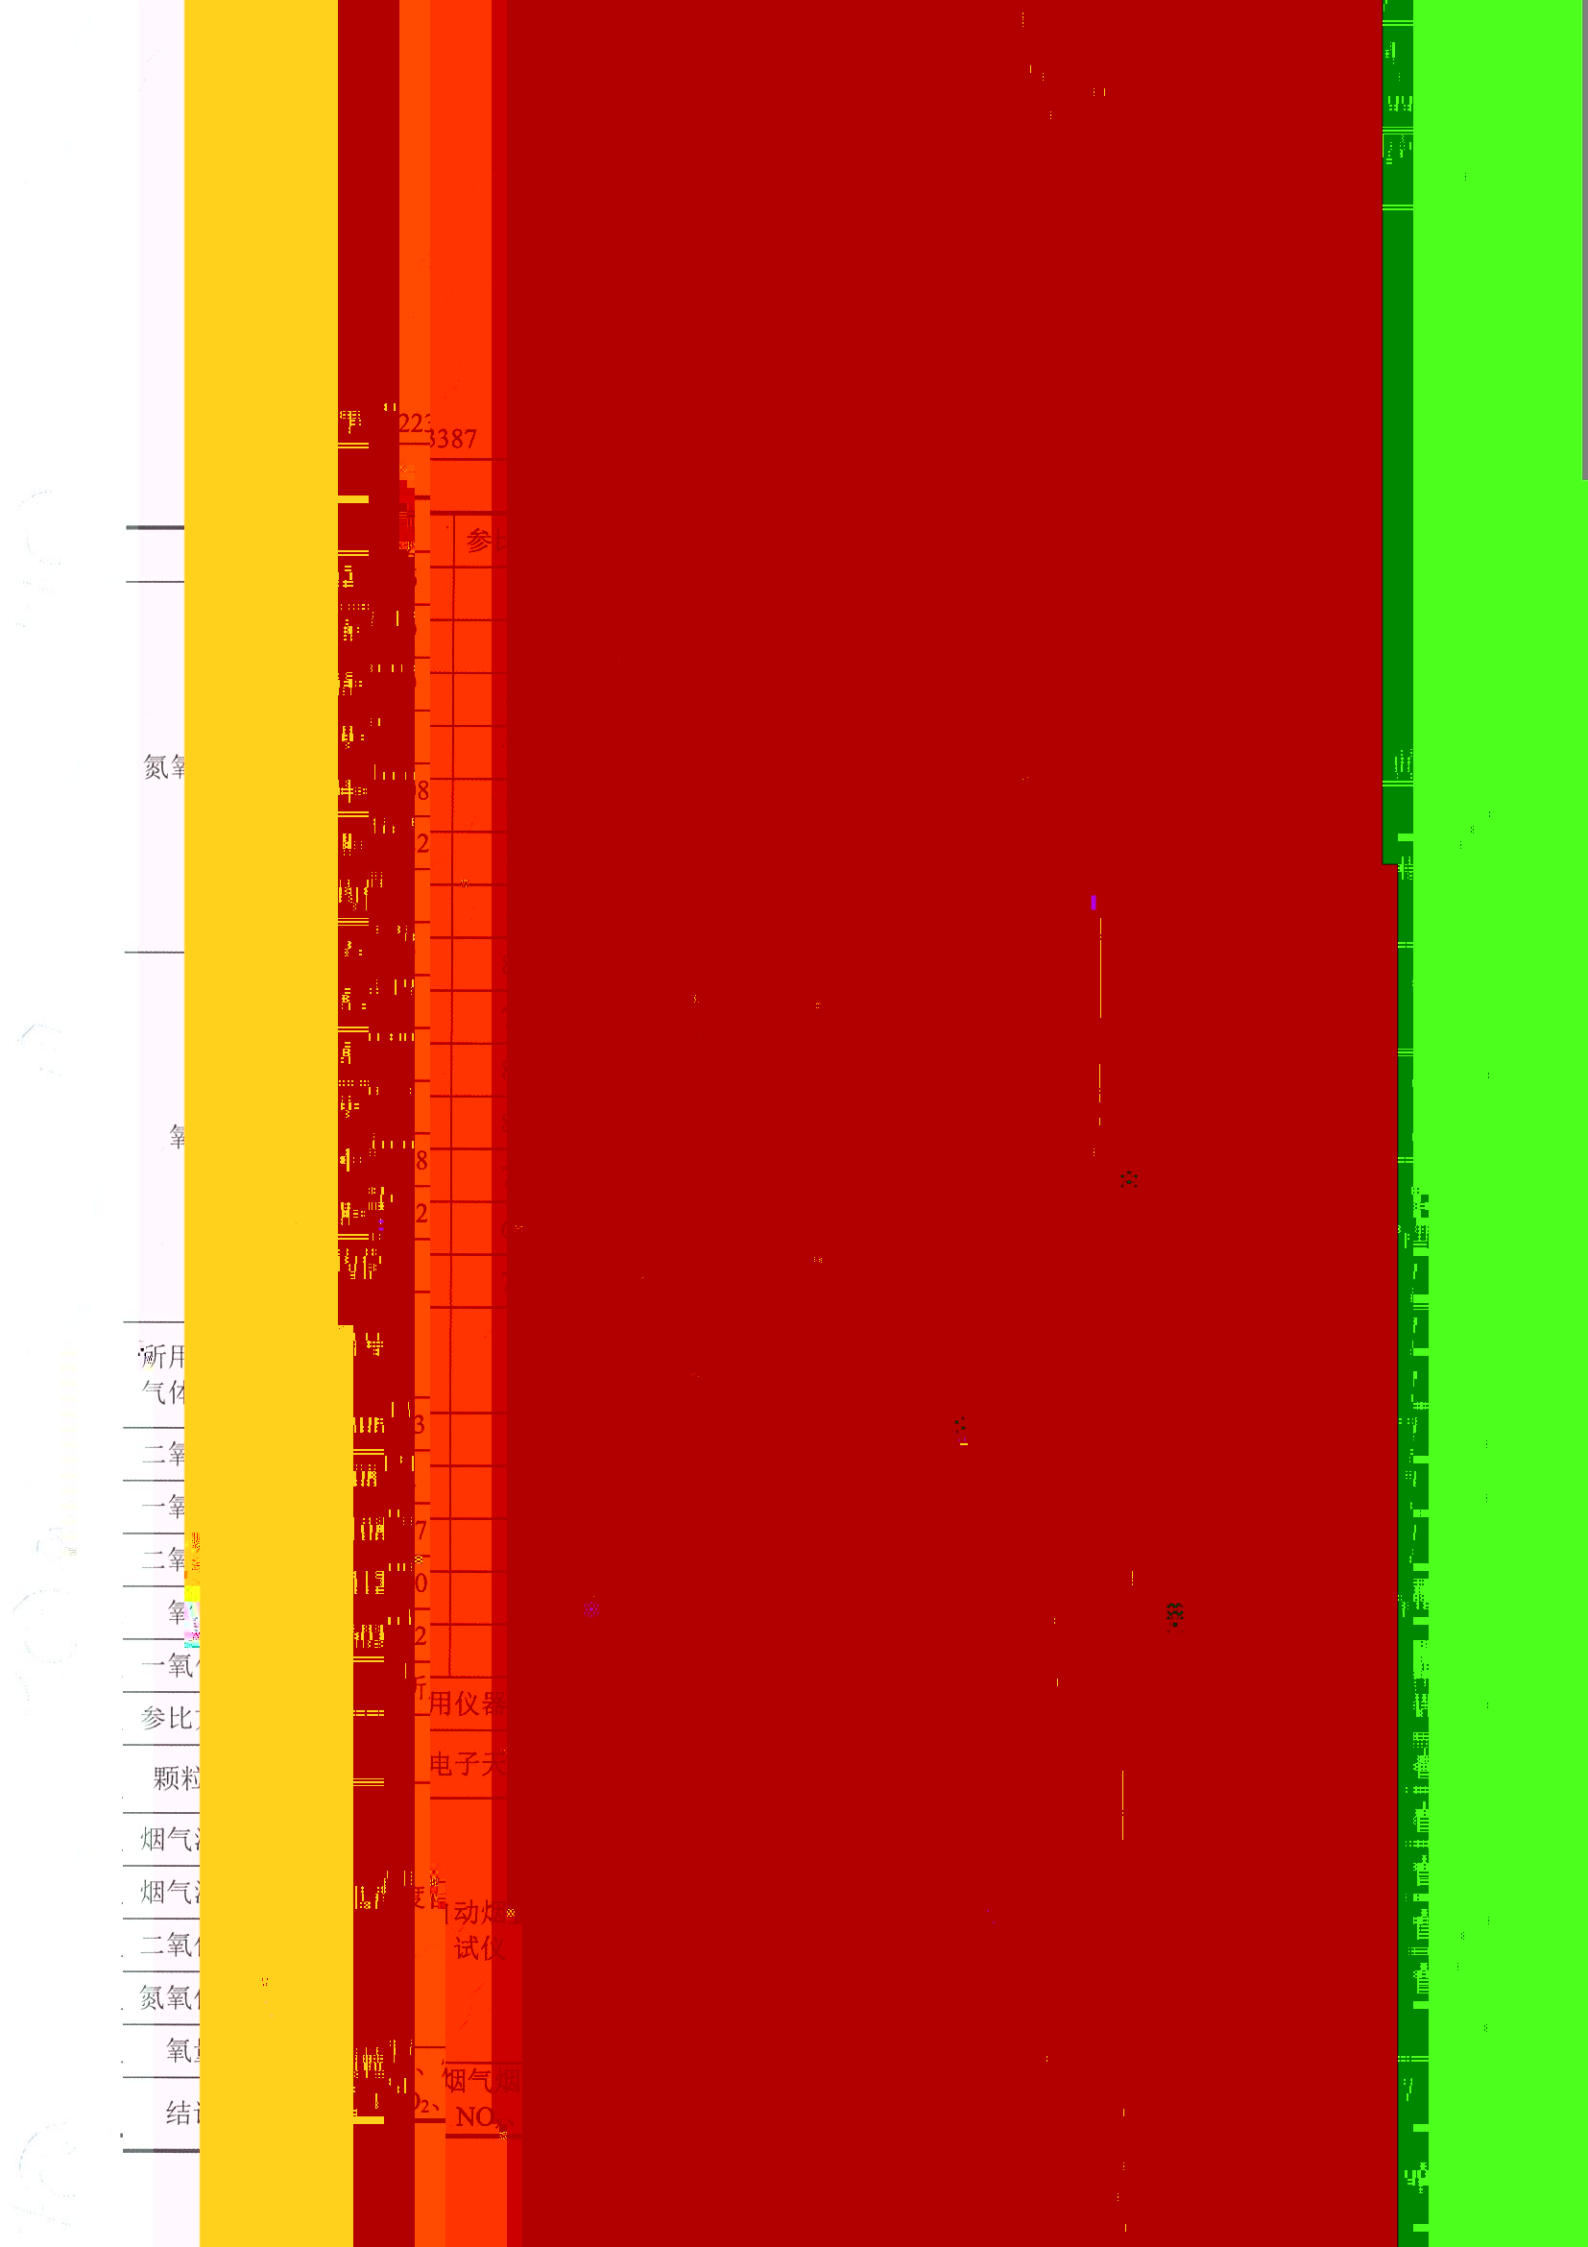

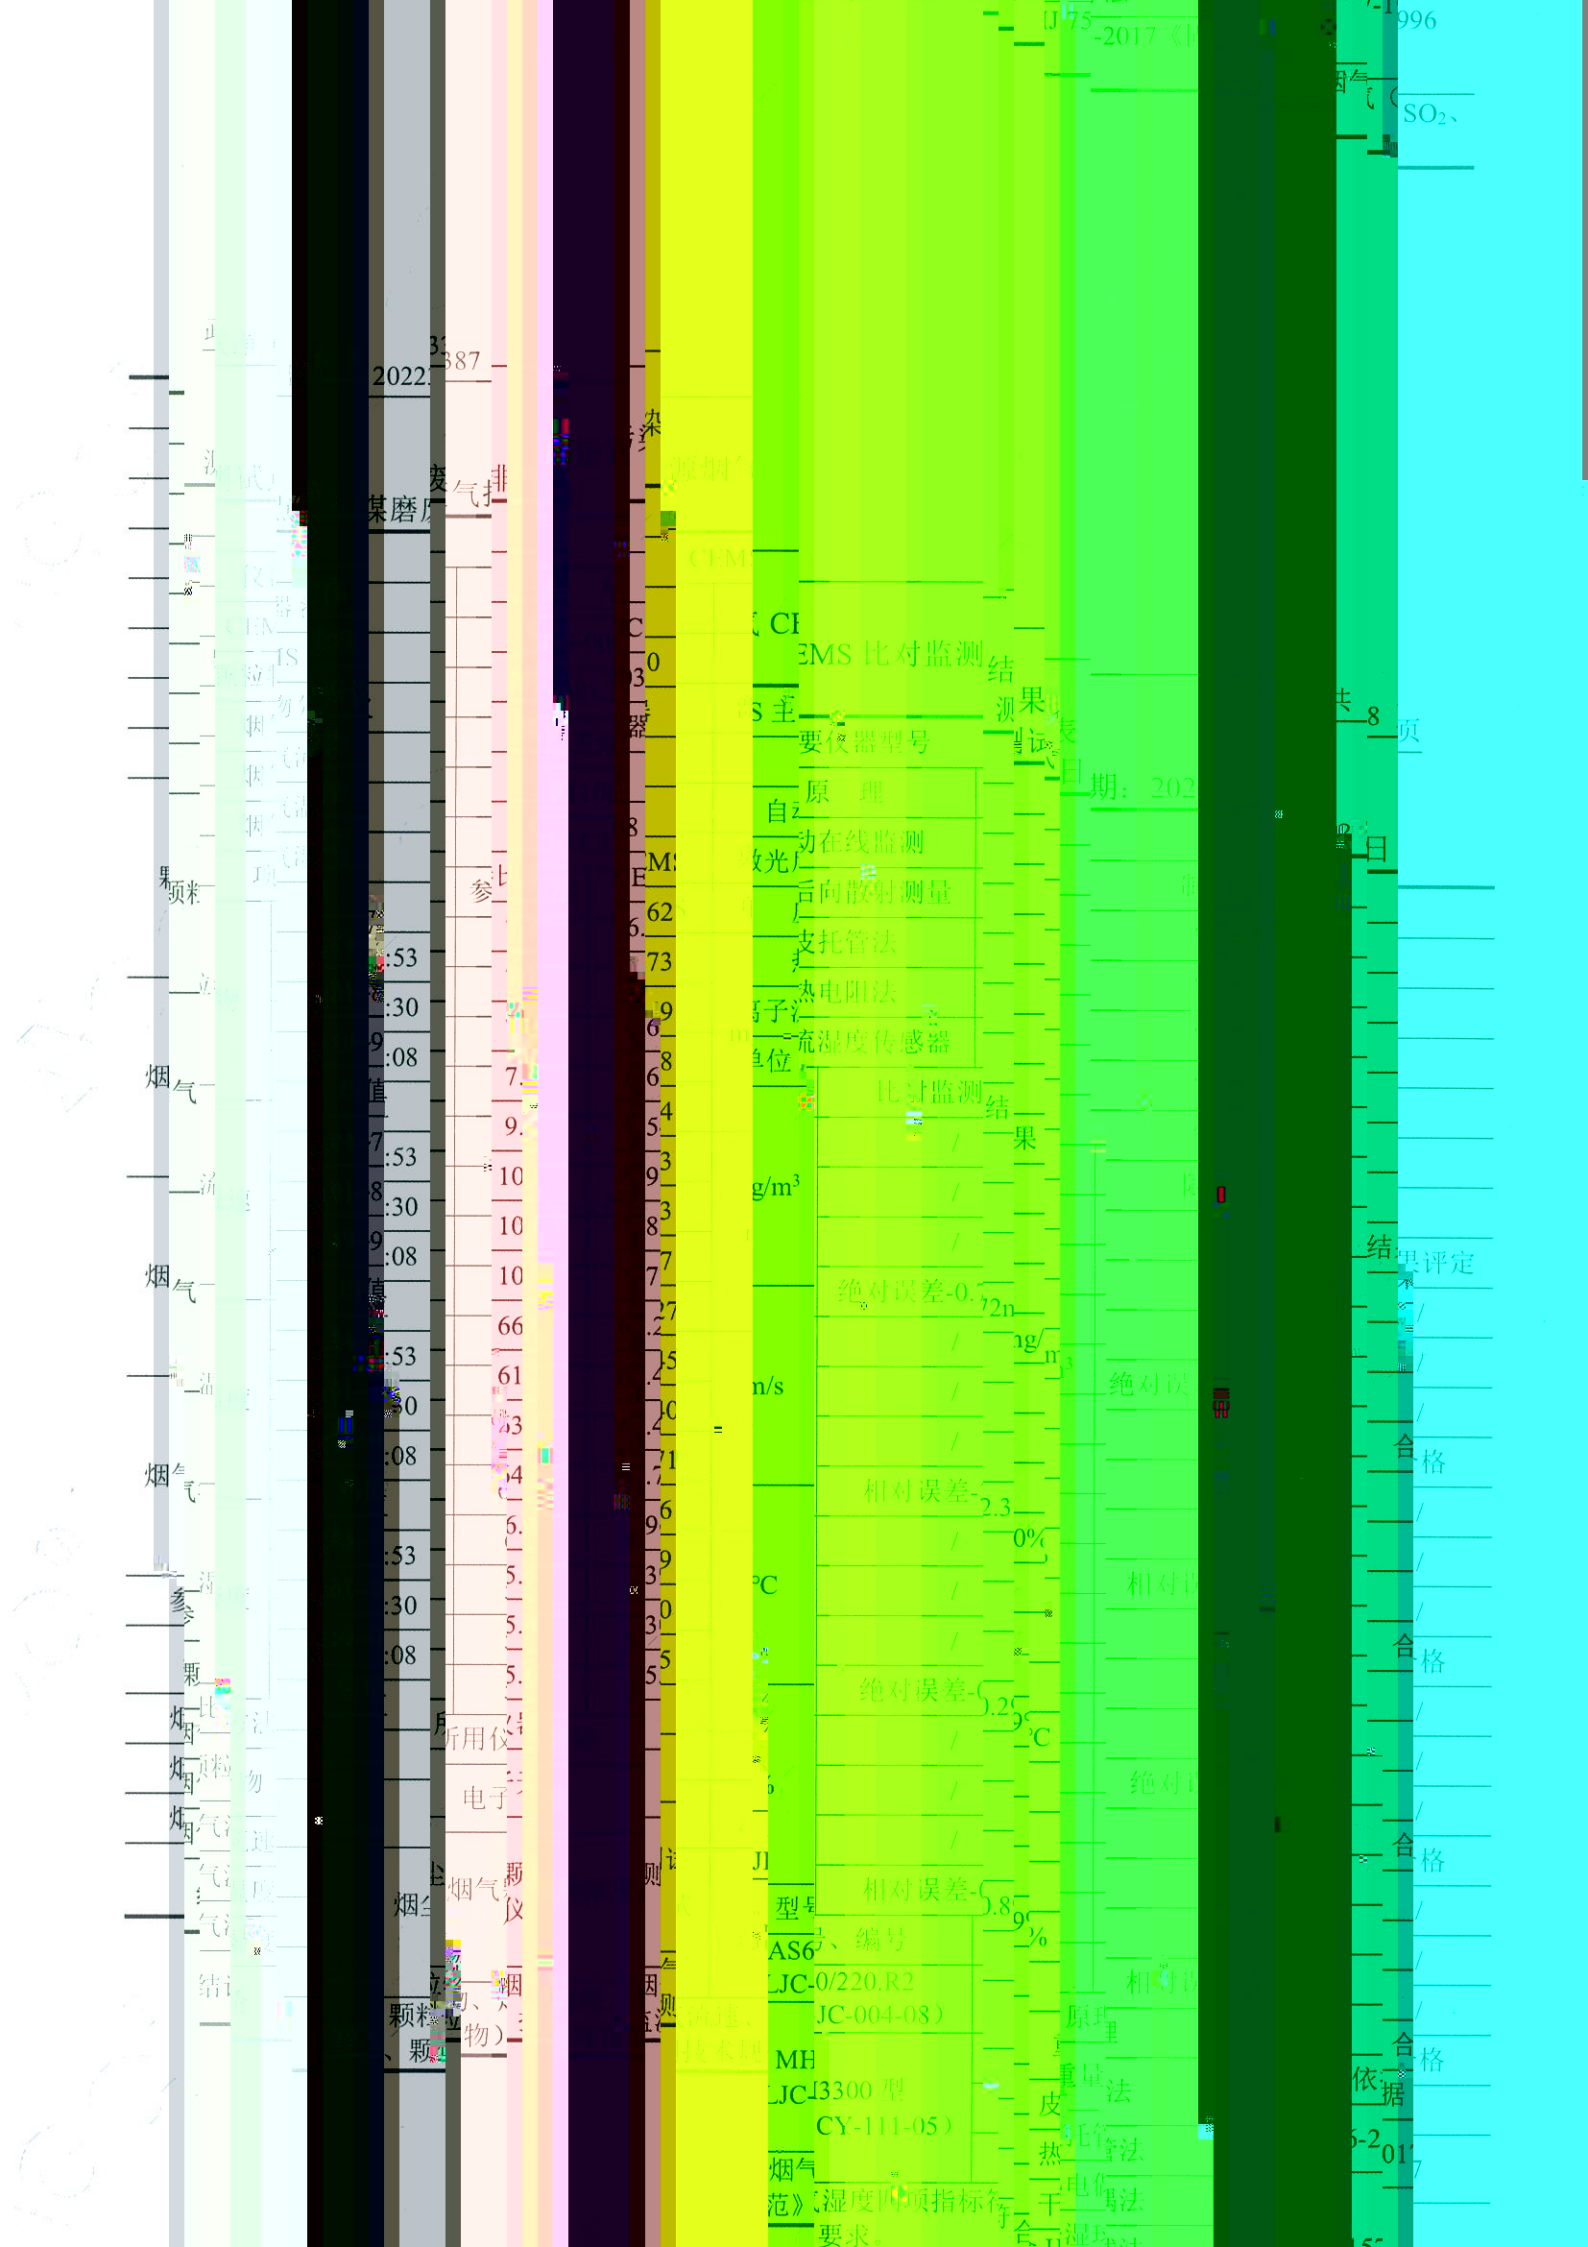

净（监

试点位：

仪器名称
系统
CEMS
析仪
粒物
烟气流速
烟气温度
烟气湿度
烟气湿度

| 项目 | | |

武
测
颗
颗粒物
烟气流速
烟气温度
参
比方
颗粒物
烟气流
烟气温
结论