CMA
221712050059

武汉

监

项目名称：

监测类别：

委托单位：


报告日期：


声　明


1. 报告无本公司
2. 报告涂改、缺
3. 对本检测报告
提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自
不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面
复印件应由我公司加盖
6. 除客户特别申明
品均不再留样。
7. 本报告不得用于

本公
公司
公司

邮政
电

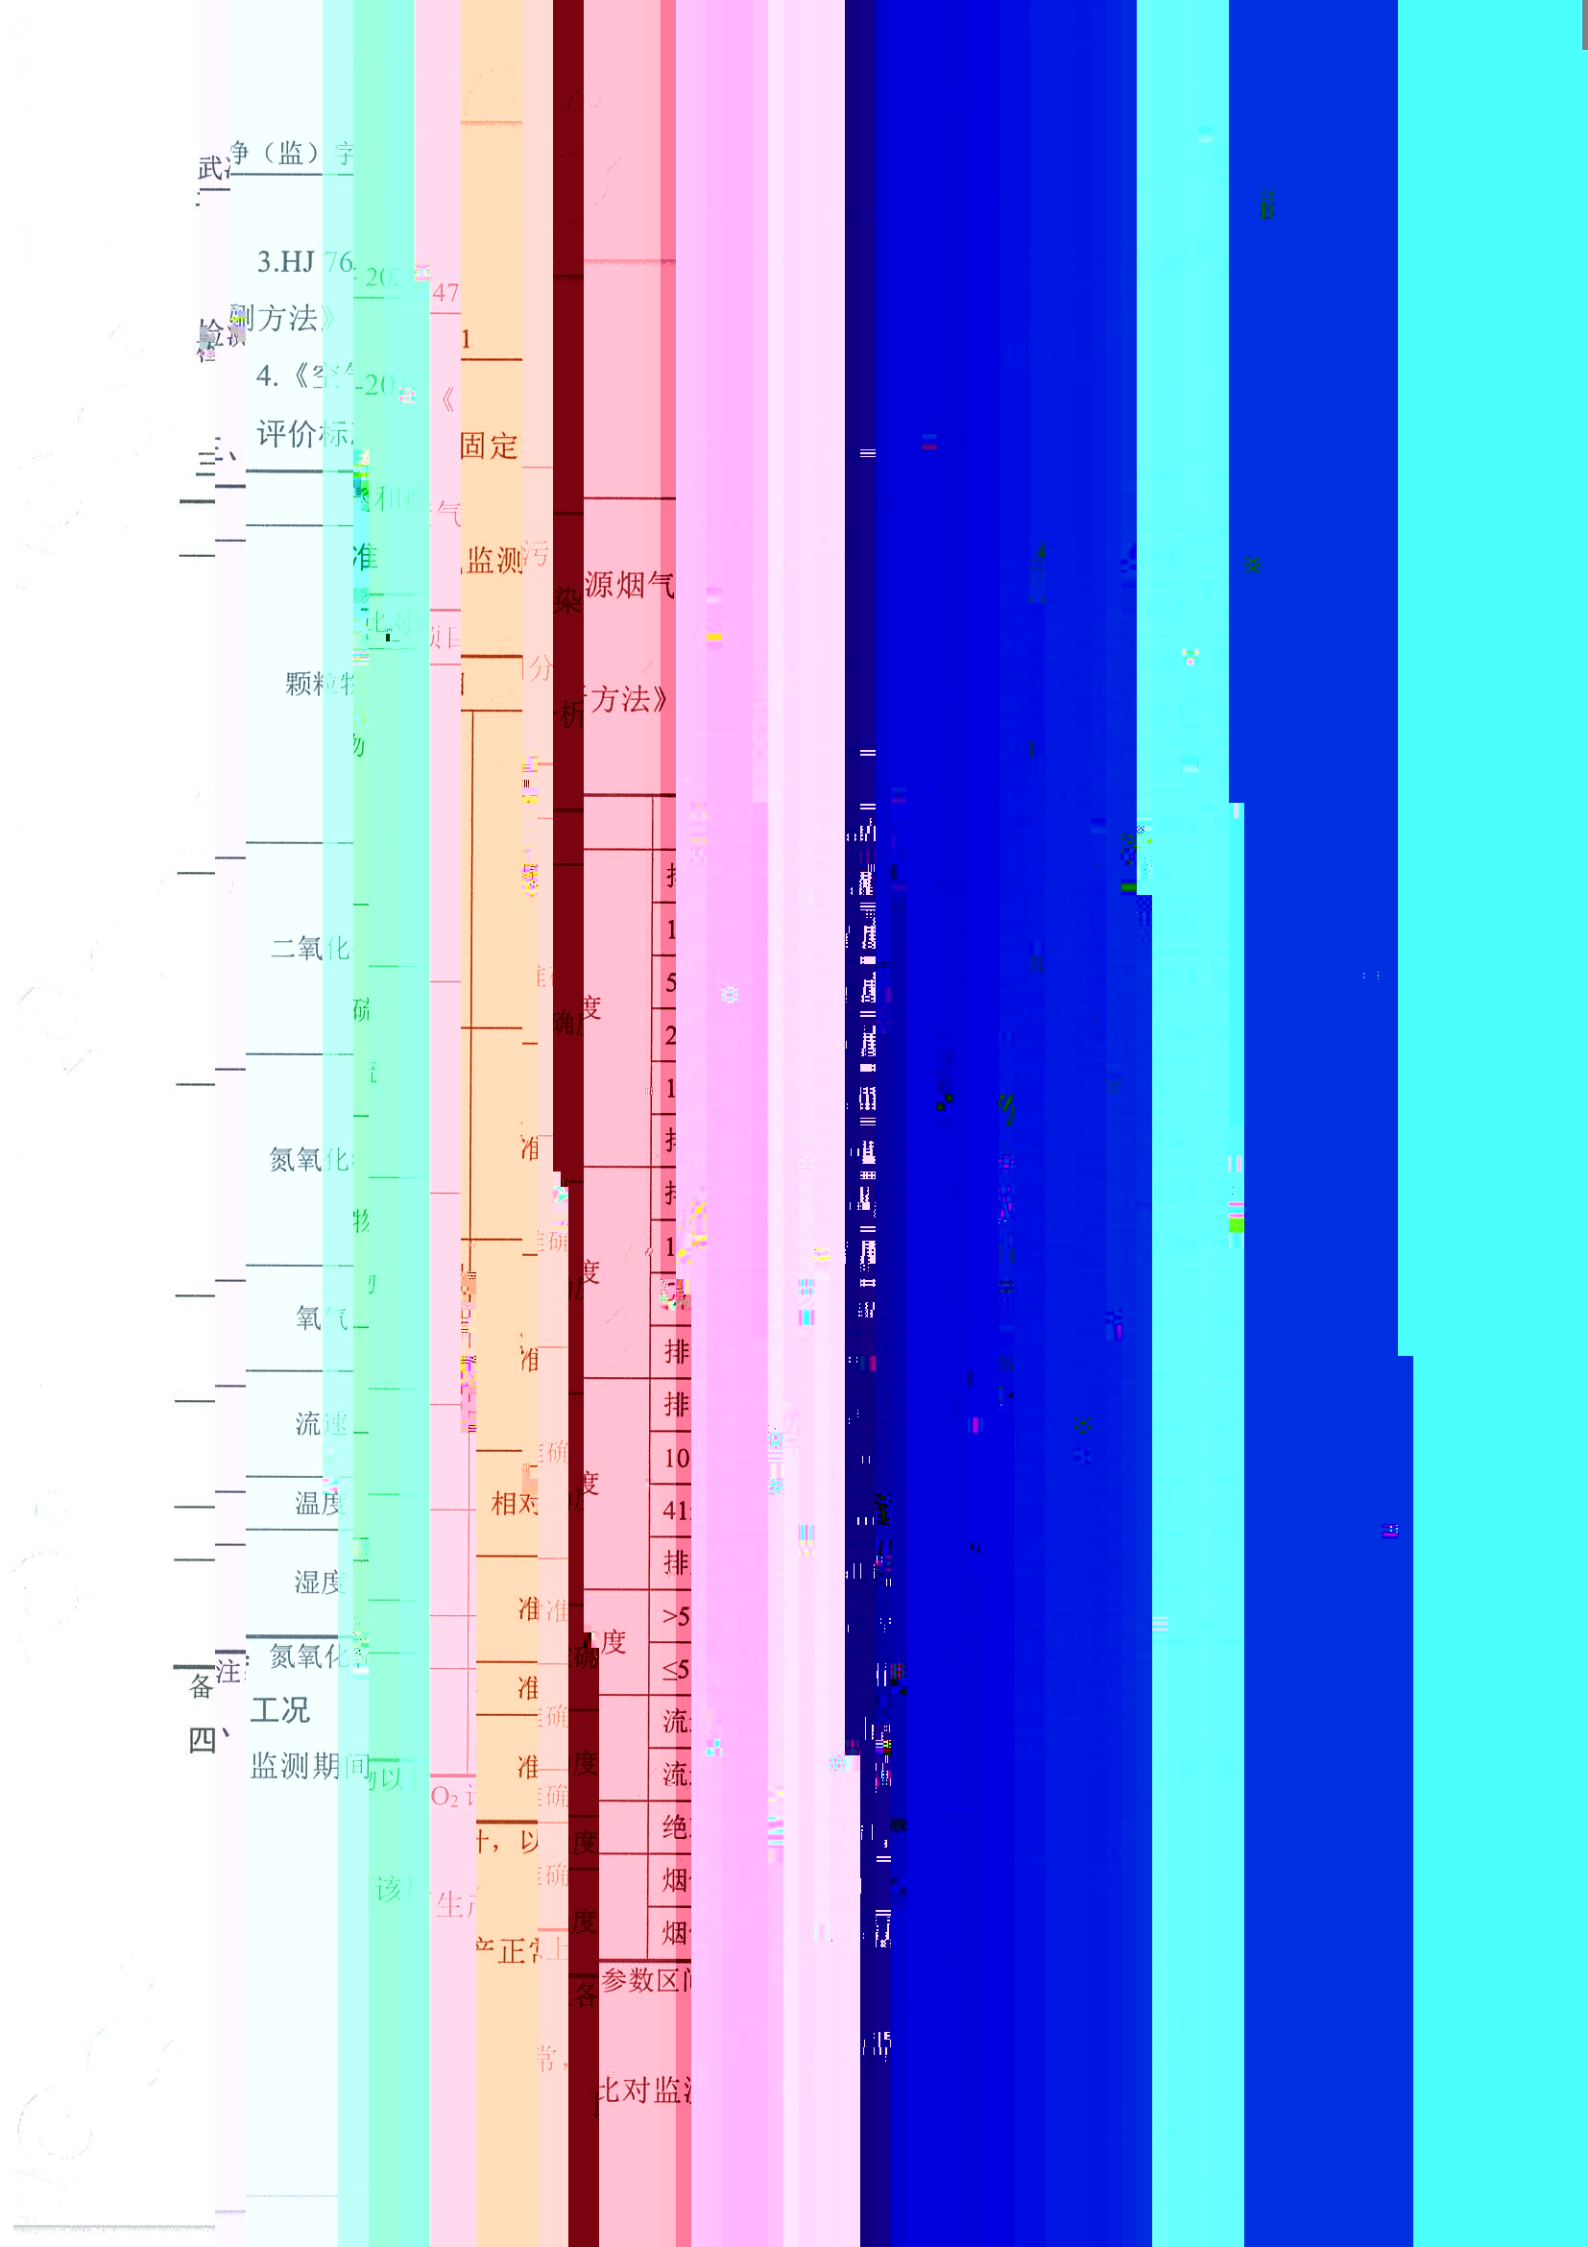

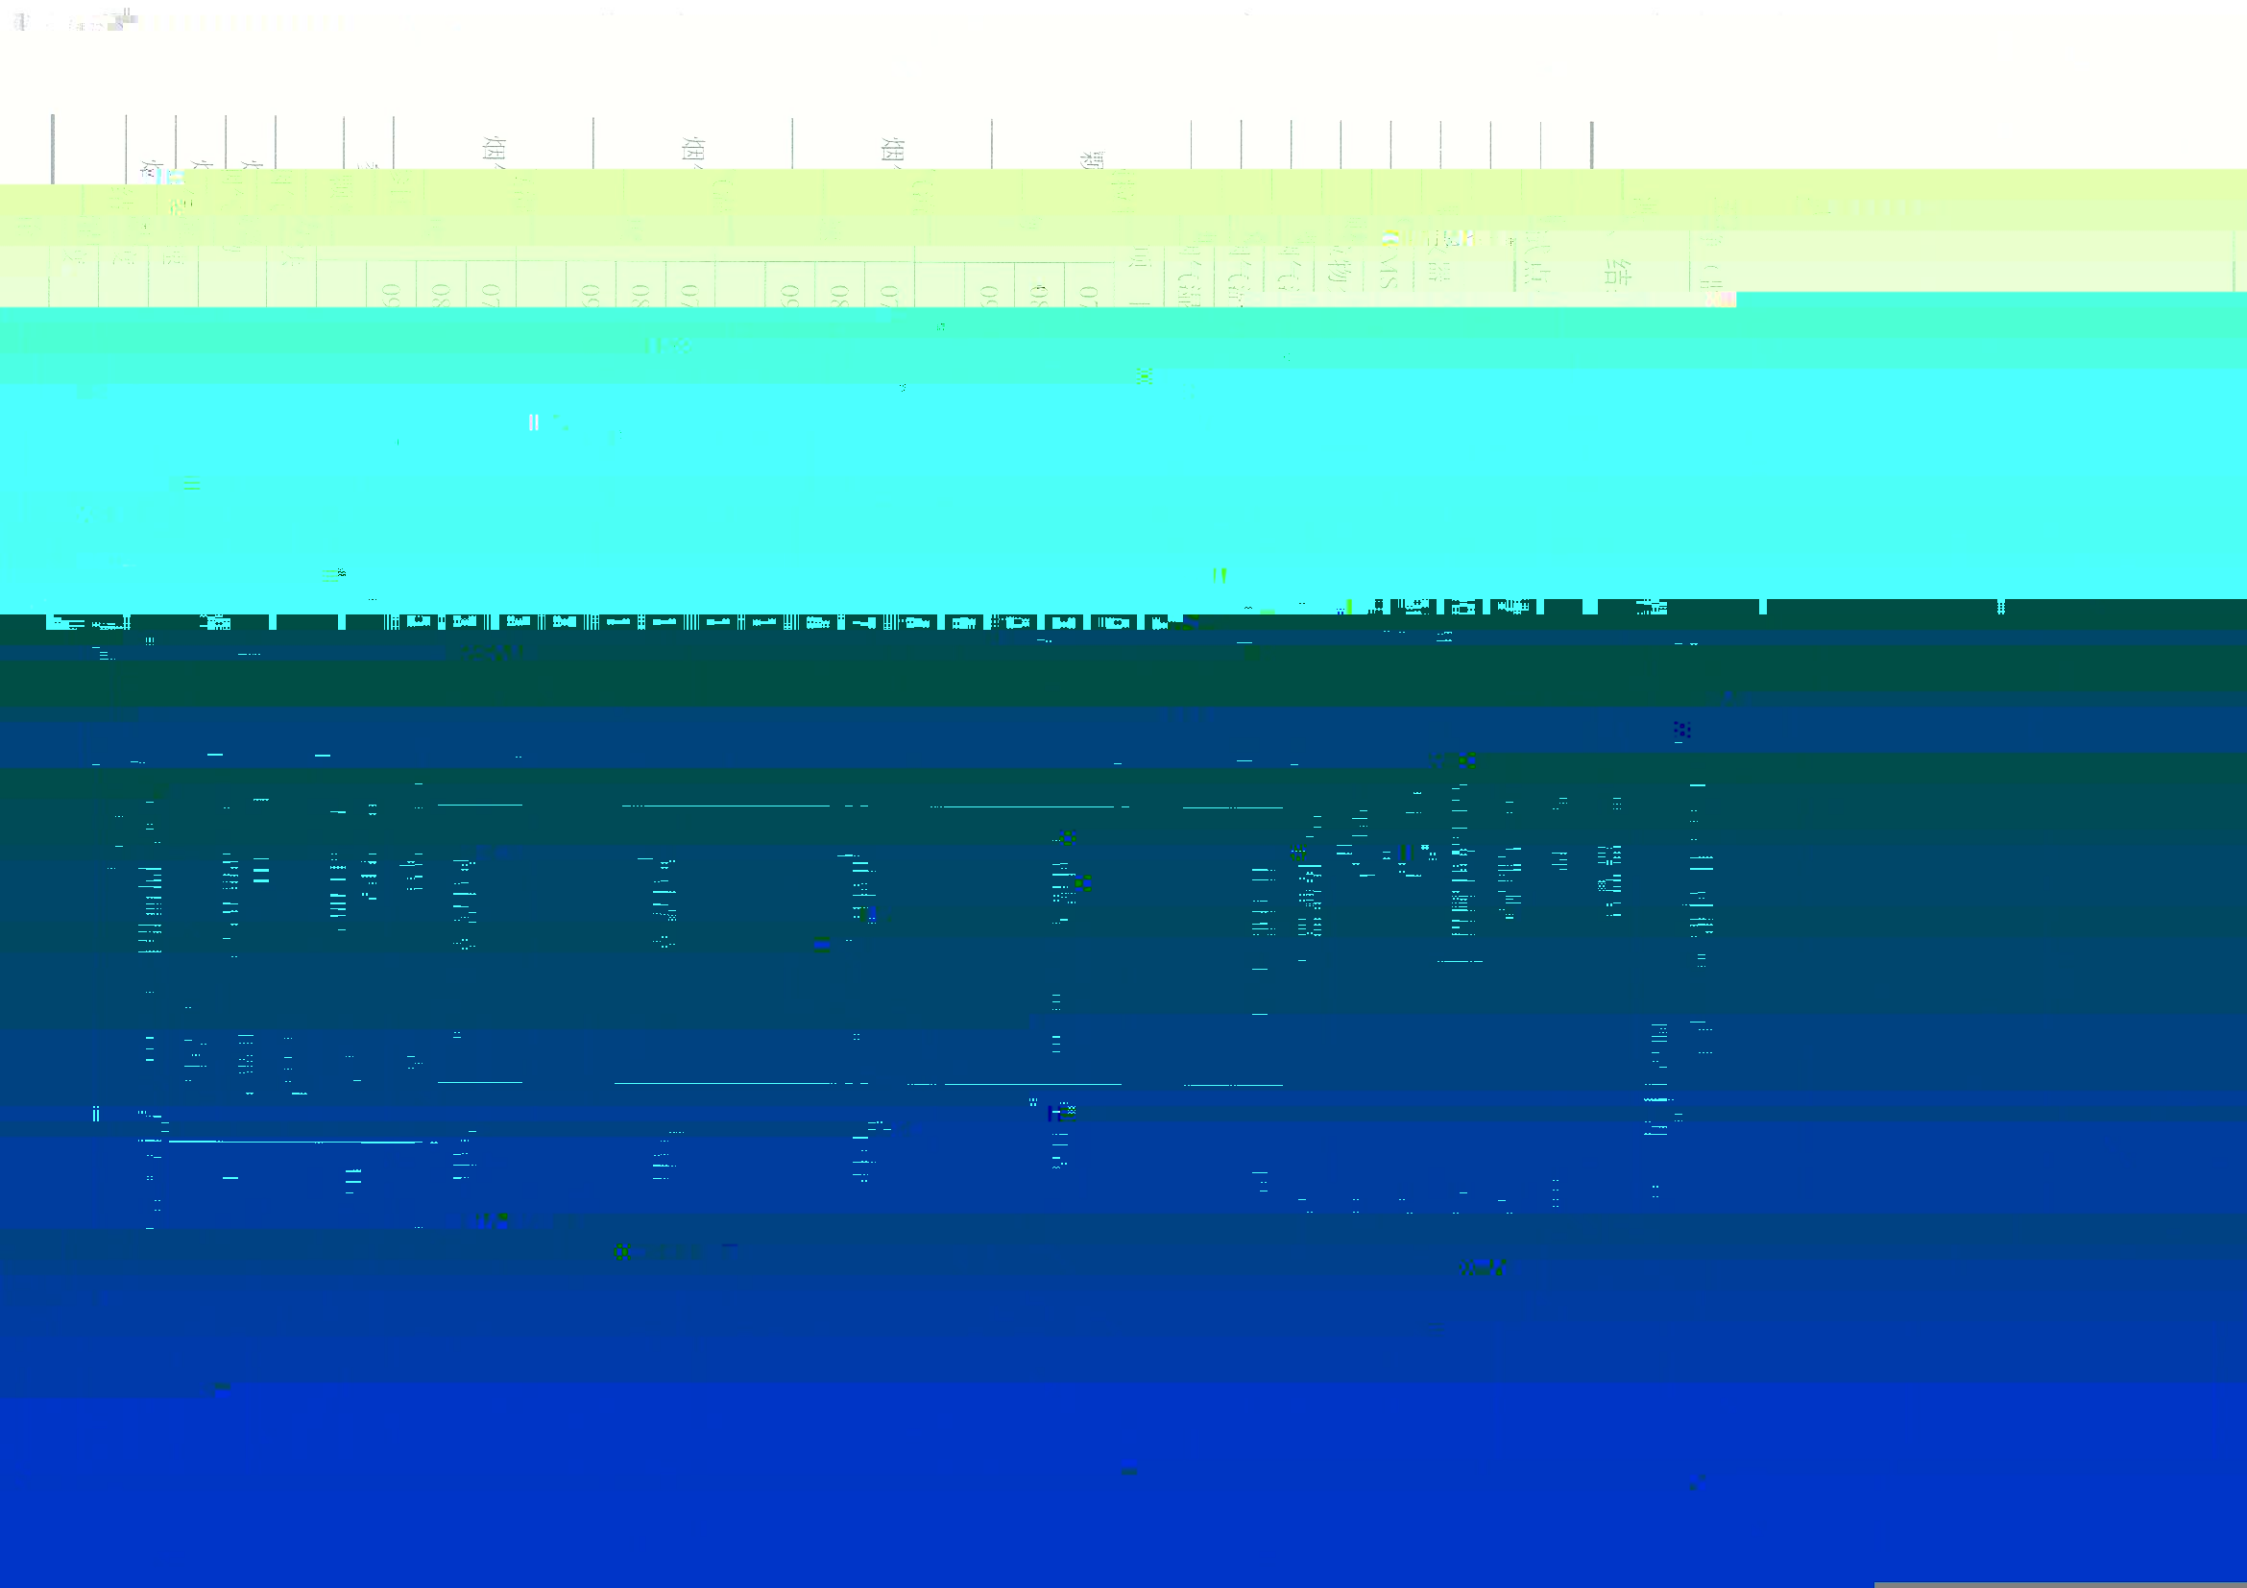

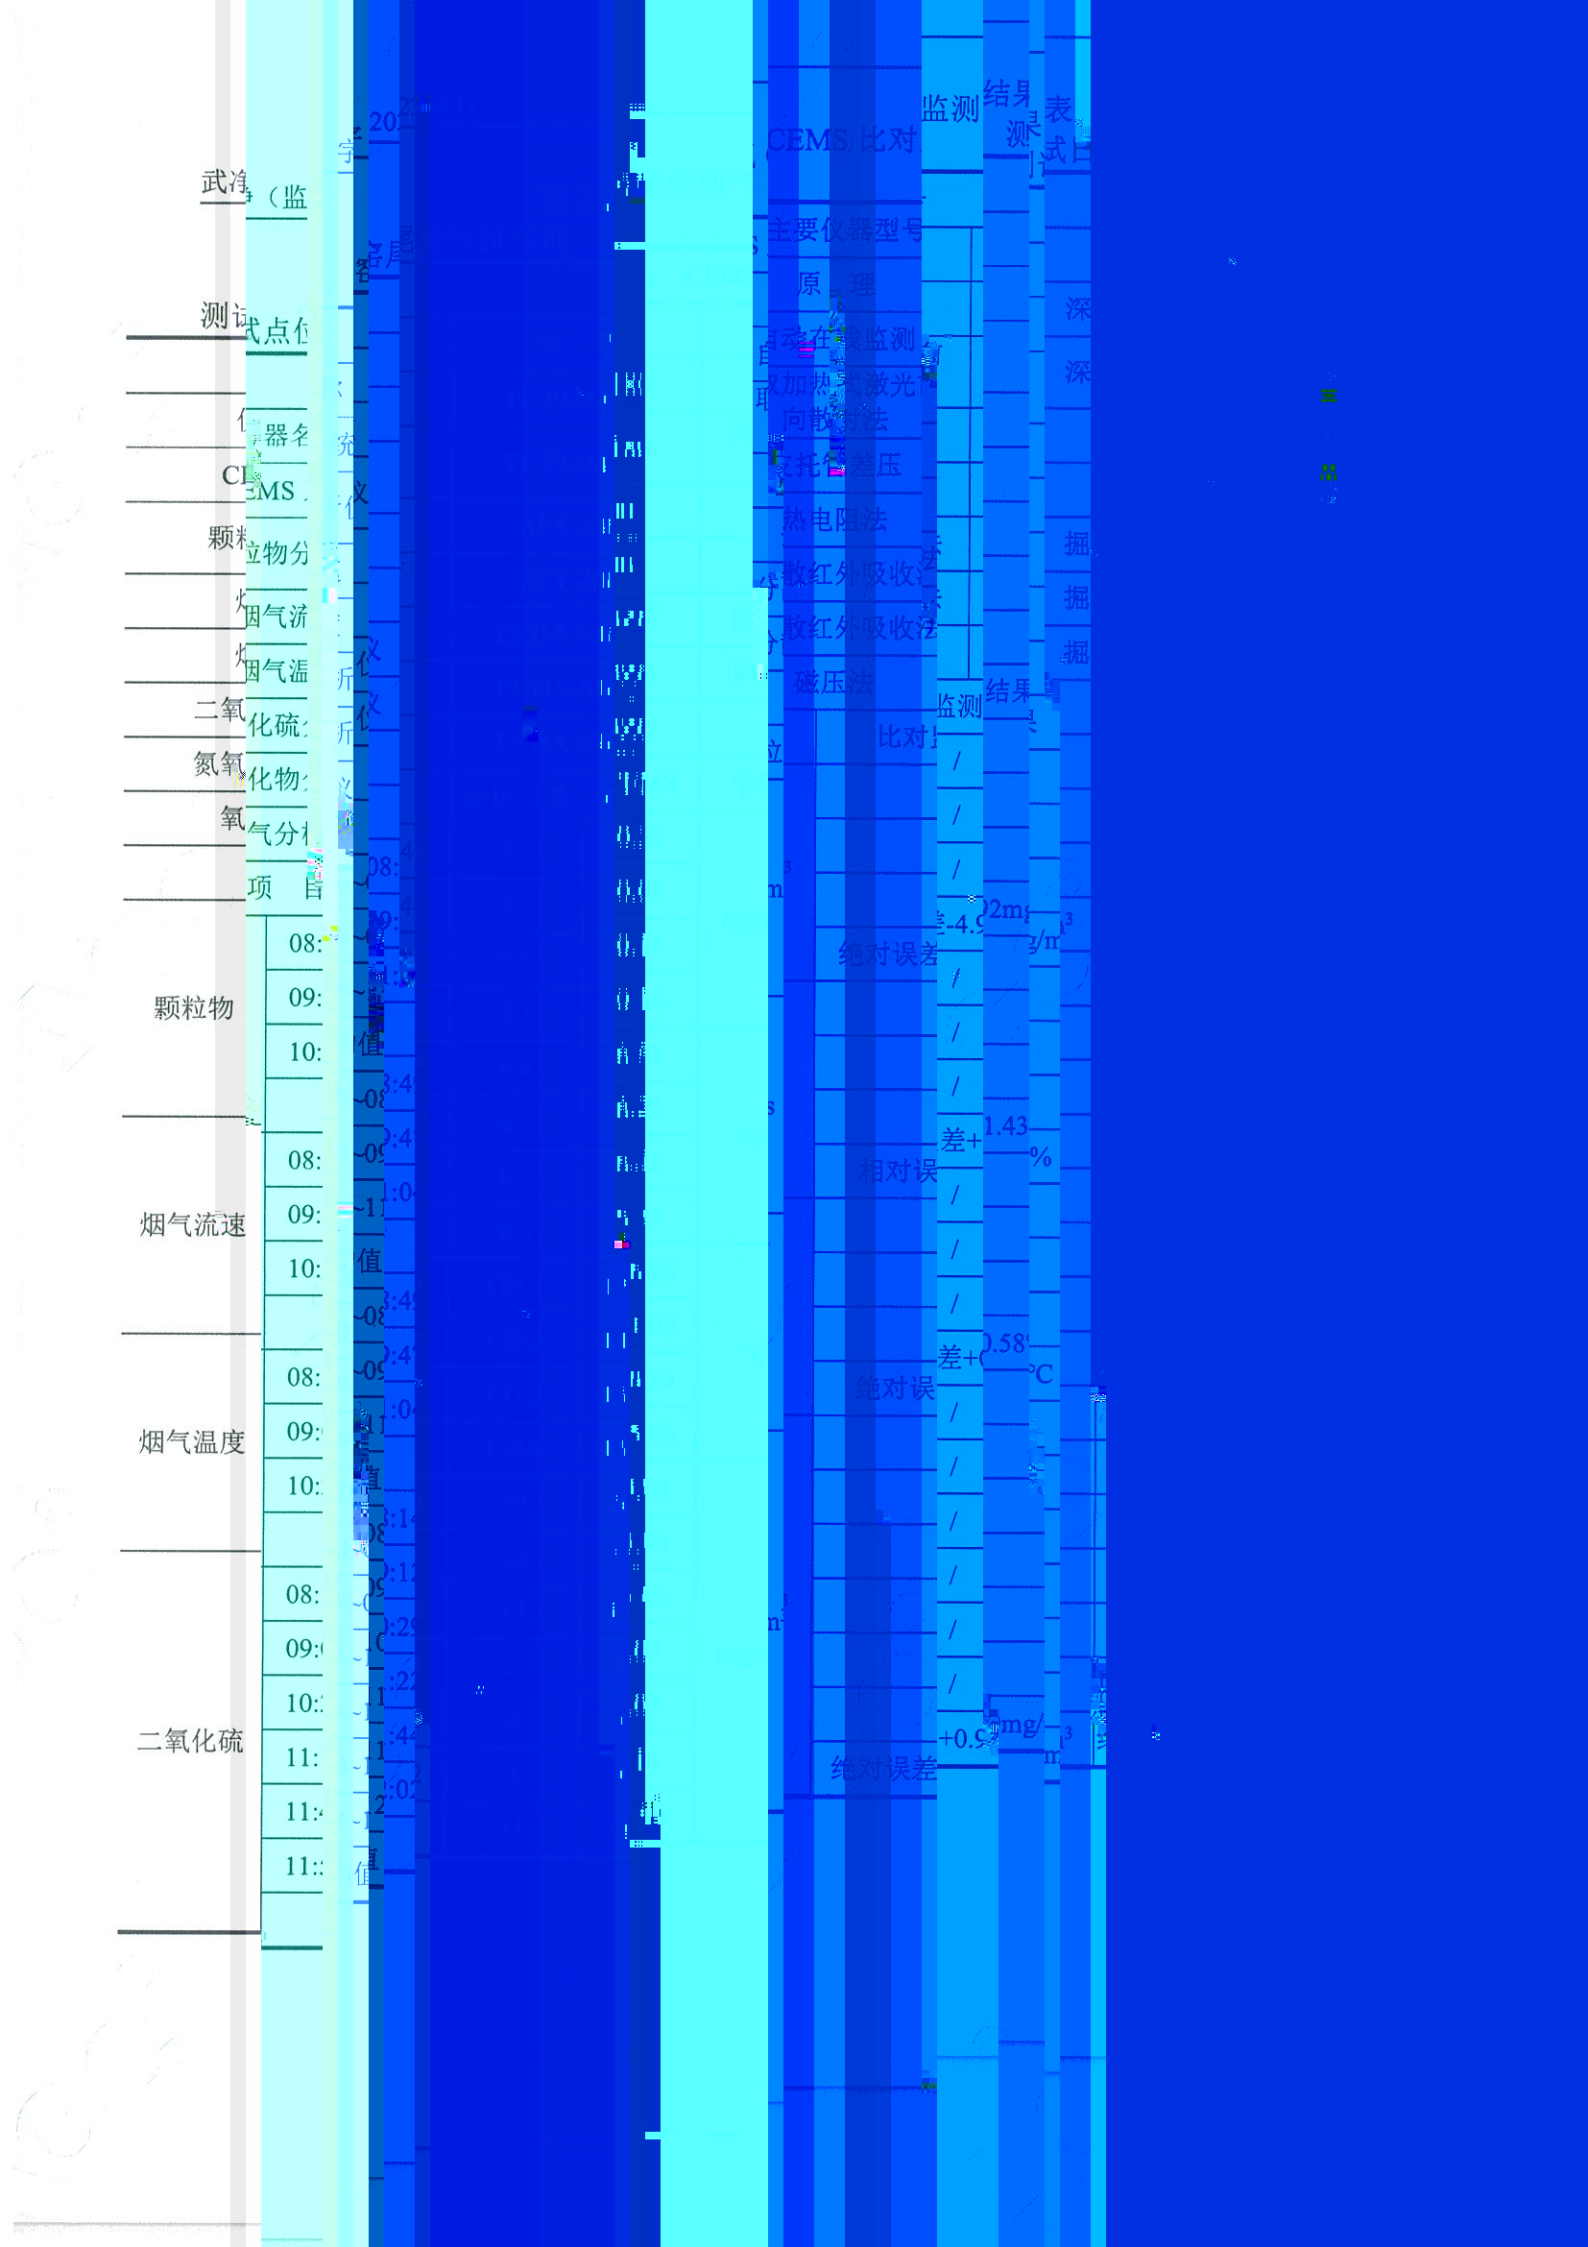
监测
CEMS 比对
主要仪器型号
原 理
热电阻法
散红外吸收法
散红外吸收法
磁压法
比对
/
绝对误差
相对误
绝对误
绝对误差
项 目
颗粒物
烟气流速
烟气温度
二氧化硫
08:
09:
10:
11:

武	20	
	08:	
	09:	
	10:	
氮氧化物	11:	
	11:	
	12:	
	直	
	08:1	
	09:1	
	10:2	
氧气	11:2	
	1:4	
	2:0	
	直	
所用标准		
二氧化硫	22	
一氧化氮	L2	
二氧化氮	L2	
氧气	L1	
一氧化碳	L1	
参比方法	所	
颗粒物		
烟气流速		
烟气温度		
二氧化硫	尘烟	
氮氧化物		
氧气		
结论	物 SO	

年 8 月 22 日

结果	评定
±5mg/m	合格
≤±10%	合格
≤±3℃	合格
≤±25%	合格
依据	检出限 mg/m³
6-2017	1.0
157-19	6
烟气（S	O_2、

武净（监）字 2

测试点位：1#

项 目			
颗粒物	07:10~07:49		
	07:56~08:35		
	08:43~09:22		
	均值		
烟气流速	07:10~07:49		
	07:56~08:35		
	08:43~09:22		
	均值		
烟气温度	07:10~07:49		
	07:56~08:35		
	08:43~09:22		
	均值		
烟气湿度	07:10~07:49		
	07:56~08:35		
	08:43~09:22		
	均值		
参比方法			
颗粒物			
烟气流速			
烟气温度			
烟气湿度			
结论			

仪器名称

CEMS 系统

颗粒物分析仪

烟气流速

烟气温度

烟气湿度

